

Catalyst One*

Analizator biochemiczny

Instrukcja obsługi

Informacja dotycząca praw własności

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadamiania. Firmy, nazwiska i dane użyte w przykładach są fikcyjne, o ile nie podano inaczej. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać ani przysyłać w jakiegokolwiek formie ani jakimikolwiek środkami, elektronicznie, mechanicznie ani w inny sposób, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody IDEXX Laboratories. IDEXX Laboratories może posiadać patenty lub rozpatrywane aktualnie wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej dotyczące tego dokumentu lub przedmiotu tego dokumentu. Udostępnienie tego dokumentu nie oznacza przyznania licencji w zakresie tych praw własności, chyba że wyraźnie to zaznaczono w pisemnej umowie licencyjnej ze strony IDEXX Laboratories.

© 2022 IDEXX Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. • 06-0038473-01

*IDEXX VetLab, Catalyst, Catalyst One, VetTrol, SmartLink, IDEXX InterLink, IDEXX SmartService, SNAP i 4Dx to znaki towarowe albo zastrzeżone znaki towarowe IDEXX Laboratories, Inc. w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszystkie inne nazwy produktów i firm oraz logo są znakami towarowymi ich właścicieli.

Spis treści

Wstęp	5
Środki bezpieczeństwa.....	5
Środki ostrożności dotyczące działania urządzenia.....	5
Ochrona analizatora	5
Opisy symboli międzynarodowych.....	6
Pozostałe symbole.....	7
Rozpoczęcie pracy	8
Wprowadzenie.....	8
Elementy analizatora Catalyst One	9
Stan analizatora	10
Reakcja na Powiadomienia	11
Montaż analizatora Catalyst One.....	11
Materiały eksploatacyjne analizatora Catalyst One.....	12
Kompatybilne gatunki	13
Używanie analizatora Catalyst One*	14
Analiza próbek.....	14
Praca ze slajdami	14
Rozcieńczanie próbek.....	14
Przeglądanie i drukowanie wyników badań	16
Próbki poza liniowością zakresu	17
Modyfikowanie ustawień analizatora	18
Modyfikowanie ustawień dźwięku [†]	18
Przechodzenie w tryb czuwania.....	18
Wychodzenie z trybu czuwania.....	18
Przygotowanie i przechowywanie próbek	19
Obsługiwane rodzaje próbek dla zestawów typu CLIP i slajdów Catalyst*	19
Przygotowanie próbek do badania w analizatorze Catalyst One	20
Odpowiednia pojemność pojemnika na próbki.....	22
Kontrola próbki po odwirowaniu.....	22
Przechowywanie próbek.....	23
Kontrola jakości	25
Informacje ogólne.....	25
Materiały kontroli jakości	25
Zestaw slajdów do kontroli jakości (Catalyst QC CLIP)	26
Przygotowywanie plyn kontrolny.....	27
Uruchamianie kontroli jakości.....	28

Konserwacja	29
Informacje ogólne	29
Aktualizowanie oprogramowania	29
Czyszczenie elementów wewnętrznych analizatora	29
Czyszczenie zewnętrznych elementów analizatora i szuflady na próbki	30
Opróżnianie szuflady na odpady	30
 Załączniki	 31
Opisy badań biochemicznych	31
Opisy protokołów medycznych	56
Różnice w wynikach	61
Parametry techniczne	61
Dane kontaktowe Działu Pomocy Technicznej IDEXX	62

Środki bezpieczeństwa

Uwaga: Używanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem może prowadzić do zmniejszenia skuteczności zabezpieczeń urządzenia.

Analizator nie zawiera żadnych części podlegających serwisowaniu przez użytkownika. NIE WOLNO rozmontowywać urządzenia.

Napięcie sieciowe zasilacza sieciowego Catalyst One wynosi 100–240 V AC przy 50–60 Hz. Należy podłączać urządzenie do odpowiednio uziemionych gniazd elektrycznych.

Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego.

Odłączyć przewód zasilający:

- jeśli przewód jest popękany albo uszkodzony w jakikolwiek inny sposób;
- jeśli na urządzenie rozlano jakikolwiek płyn;
- jeśli urządzenie jest narażone na nadmierną wilgoć;
- w przypadku upuszczenia urządzenia albo uszkodzenia obudowy;
- w przypadku podejrzenia, że analizator wymaga serwisowania albo naprawy;
- za każdym razem podczas czyszczenia obudowy.

Środki ostrożności dotyczące działania urządzenia

Nie należy używać w urządzeniu ani w jego pobliżu określonych płynów, aerozoli (takich jak sprężone powietrze), rozpuszczalników, amoniaku ani innych substancji, które mogłyby wpłynąć na wyniki.

Ochrona analizatora

Nie zaleca się stawiania innych urządzeń ani pojemników na analizatorze.

Należy chronić analizator przed źródłami ciepła albo ognia.

NALEŻY CHRONIĆ urządzenie przed wilgocią, deszczową pogodą albo rozlaniem płynu.

Należy uważać, aby nie rozlać na urządzenie wody ani innych płynów.

NIE WOLNO UŻYWAĆ rozpuszczalników, markerów tuszowych, aerozoli zawierających ciecze lotne ani środków nadających połysk, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie obudowy zewnętrznej. Czyścić wyłącznie łagodnym mydłem i lekko zwilżoną ściereczką oraz wyłącznie wtedy, gdy analizator nie jest używany.

Czyścić wyłącznie łagodnym mydłem i lekko zwilżoną ściereczką oraz wyłącznie wtedy, gdy analizator nie jest używany.

Opisy symboli międzynarodowych


Symbole międzynarodowe są zwykle stosowane na opakowaniu w celu przedstawienia w formie graficznej określonych informacji związanych z produktem (takich jak data ważności, zakres temperatur, kod partii itd.). Firma IDEXX Laboratories stosuje symbole międzynarodowe na analizatorach, opakowaniach produktów, etykietach, ulotkach oraz instrukcjach w celu zapewnienia użytkownikom łatwych do odczytania informacji.


Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Data ważności A utiliser avant Verwendbar bis Usare entro Usar antes de 使用期限		Zakres temperatur Température limite Zulässiger Temperaturbereich Temperatura limite Limitación de temperatura 保存温度 (下限)
	Kod partii (serii) Code de lot (Lot) Chargenbezeichnung (Partie) Codice del lotto (partita) Código de lote (Lote) ロット番号		Górny limit temperatury Limite supérieure de température Temperaturobergrenze Limite superiore di temperatura Limite superior de temperatura 保存温度 (上限)
	Numer seryjny Numéro de série Seriennummer Numero di serie Número de serie シリアル番号		Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi Consulter la notice d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten Consultare le istruzioni per l'uso Consultar las instrucciones de uso 取扱説明書をご参照ください。
	Numer katalogowy Numéro catalogue Bestellnummer Numero di catalogo Número de catálogo 製品番号		Chronić przed światłem słonecznym Conserver à l'abri de la lumière Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen Mantener alejado de la luz solar Tenere lontano dalla luce diretta del sole 遮光してください。
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej Représentant agréé pour la C.E.E. Autorisierte EG-Vertretung Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea Representante autorizado en la Comunidad Europea EC内の正規販売代理店		Dyrektywa WEEE 2002/96/WE Dyrektywa 2002/96/CE (DEEE) WEEE-Richtlinie 2002/96/EG Directiva 2002/96/CE RAEE Direttiva RAEE 2002/96/CE 廃電気電子機器指令 (WEEE Directive 2002/96/EC)
	Producent Fabricant Hersteller Ditta produttrice Fabricante 製造元		Zagrożenie biologiczne Risques biologiques Biogefährlich Rischi biologici Riesgos biológicos 生物学的リスク
	Uwaga, należy zapoznać się z załączoną dokumentacją Attention, consulter les documents joints Achtung, Begleitdokumente beachten Attenzione, consultare la documentazione allegata Precaución, consultar la documentación adjunta 注意、添付文書をご参照ください。		Nie używać ponownie Usage unique Nicht wiederverwenden No reutilizar Non riutilizzare 再利用しないでください。

Symbol	Opis
	Uwaga, gorąca powierzchnia Attention, surface très chaude Precaución, superficie caliente Vorsicht, heiße Oberfläche Attenzione, superficie rovente 高温注意
	Chronić przed wilgocią Conserver dans un endroit sec Mantener seco Vor Nässe schützen Tenere al riparo dall'umidità 濡らさないこと。
	Tą stroną do góry Haut Este lado hacia arriba Diese Seite nach oben Alto この面を上にする。
	Nie zamrażać

Symbol	Opis
	Urządzenie wrażliwe na oddziaływania elektrostatyczne Appareil sensible aux charges électrostatiques Dispositivo sensible a descargas electrostáticas Gerät ist sensibel auf elektrostatische Ladung Dispositivo sensible alle scariche elettrostatiche 静電気の影響を受ける装置
	Ostrożnie Fragile Fragil Zerbrechlich Fragile 取扱注意
	Data produkcji Date de production Fecha de producción Herstelldatum Data di produzione 製造年月日:

Pozostałe symbole

Symbol	Opis
	Symbol złącza USB

Symbol	Opis
	Symbol złącza Ethernet/złącza sieciowego

Rozpoczęcie pracy

Wprowadzenie

Zapraszamy do zapoznania się z analizatorem biochemicznym IDEXX nowej generacji – analizatorem biochemicznym Catalyst One*.

Elastyczne menu testowe analizatora Catalyst One umożliwia monitorowanie czynności określonych narządów, ponowne sprawdzenie wartości wyników wcześniejszych badań oraz dostosowanie profili poprzez dodanie pojedynczych badań do zestawów typu CLIP. Możliwe jest wykonanie nawet 25 badań jednej próbki (pełna lista dostępnych pojedynczych slajdów i zestawów typu CLIP – patrz strona 12).

Analizator Catalyst One służy wyłącznie do użytku weterynaryjnego.

Łączność ze stacją IDEXX VetLab*

Analizator Catalyst One stanowi element zestawu analizatorów IDEXX VetLab*, a wszystkie z nich łączą się ze stacją IDEXX VetLab (system zarządzania danymi laboratoryjnymi firmy IDEXX). Połączenie kilku analizatorów ze stacją IDEXX VetLab pomaga uzyskać szczegółowy obraz stanu zdrowia pacjenta dzięki możliwości przeglądania wyników badań z kilku analizatorów w jednym sprawozdaniu, określenia progresji choroby na podstawie trendu parametrów i nie tylko.

Połączenie analizatora Catalyst One ze stacją IDEXX VetLab umożliwia:

- automatyczne przeglądanie wcześniejszych wyników badań pacjenta na każdym wydruku i łatwe ich porównywanie;
- poprawę komunikacji z klientem dzięki ilustrowanym wydrukom z wynikami badań diagnostycznych albo postępami leczenia;
- umieszczanie łączy do opisów dokonanych przez specjalistów oraz częstych przyczyn nieprawidłowych wartości;
- drukowanie informacji pomocnych w wytłumaczeniu klientom znaczenia wyników;
- niezależne szkolenie nowych członków personelu;
- naukę odpowiednich protokołów i wskazówek dotyczących najlepszych technik.

Opatentowane technologie preparatów

Opatentowane technologie stosowane w preparatach Catalyst* minimalizują ilość substancji interferujących:

- Technologia suchego preparatu IDEXX wykorzystuje wiele technologii, które minimalizują obecność substancji interferujących podczas przemieszczania próbki z górnej do dolnej warstwy, gdzie jest ona analizowana.
- Warstwy wyłapujące i/lub rozprowadzające odfiltrują substancje interferujące z innych składników krwi, zapewniając jakość próbki.
- Zintegrowany proces płukania jest stosowany w przypadku określonych preparatów w celu usunięcia zanieczyszczeń z próbki, co maksymalizuje czułość i dokładność wyników.

Elementy analizatora Catalyst One

Przód analizatora




Wnętrze szuflady na próbki

Uwaga: Na ilustracji wskazano miejsca w szufladzie na próbki, w których należy umieścić pojemnik na próbki i separator krwi pełnej. Nie ładuj separatora krwi pełnej ORAZ pojemnika na próbkę podczas jednej analizy.



Bok analizatora

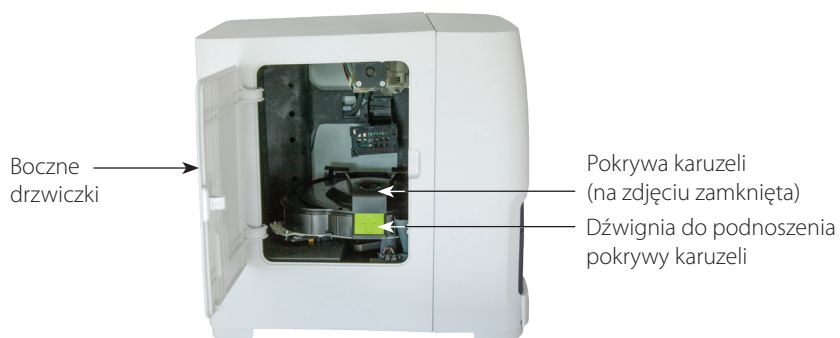

Tył analizatora



Stan analizatora

Wskaźnik z diodą (LED) na przednim panelu analizatora Catalyst One wskazuje stan analizatora.

Uwaga: Stan analizatora można również sprawdzić, sprawdzając jego ikonę na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab.

Kolor diody LED	Opis
Zielony (ciągły)	GOTOWY; analizator jest gotowy do przetwarzania próbek albo wykonywania czynności konserwacyjnych
Zielony (migający)	TRYB CZUWANIA
Żółty (ciągły)	ZAJĘTY; analizator przetwarza próbkę albo wykonuje inne działanie
Żółty (migający)	Analizator oczekuje na rozpoczęcie przetwarzania próbki przez użytkownika po otrzymaniu informacji o pacjencie ze stacji IDEXX VetLab
Czerwony (migający)	BŁĄD; wystąpił błąd; przejrzyj komunikaty o błędach albo komunikaty ostrzegawcze w stacji IDEXX VetLab

Reakcja na Powiadomienia

Gdy w analizatorze wystąpi problem, w prawej górnej części paska tytułowego stacji IDEXX VetLab zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, dioda LED umiejscowiona w przednim panelu analizatora Catalyst One zaświeci się na czerwono, a na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab wyświetli się ikona Catalyst One ze statusem Powiadomienia.

Aby zobaczyć Powiadomienie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- naciśnij ikonę Catalyst One na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab;
- Kliknij na powiadomienie na pasku tytułu, aby wyświetlić treść powiadomienia. Postępuj wedle zawartych tam instrukcji.

Montaż analizatora Catalyst One

Analizator Catalyst One współpracuje ze stacją IDEXX VetLab.

Montaż analizatora Catalyst One

1. Przed rozpakowaniem analizatora wybierz optymalne miejsce dla urządzenia. Analizator należy umieścić na równej powierzchni w dobrze wentylowanej przestrzeni, z daleka od bezpośrednich źródeł ciepła, światła słonecznego, zimna, wilgoci i drgań, z zachowaniem 5 cm odstępu w celu umożliwienia przepływu powietrza wokół analizatora. Dla uzyskania optymalnych wyników temperatura pokojowa powinna wynosić 15°C–30°C, a wilgotność względna powinna mieścić się w zakresie 15%–75%.

WAŻNE: Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Otwory wylotowe chłodzenia analizatora znajdują się w podstawie oraz z tyłu urządzenia.

2. Podłącz analizator do oznaczonego numerem złącza routera IDEXX VetLab za pomocą dostarczonego kabla Ethernet.

Uwaga: Więcej informacji na temat podłączania analizatora do routera znajduje się w instrukcji montażu dołączonej do routera.

3. Włącz analizator Catalyst One. Po nawiązaniu połączenia na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab wyświetli się ikona Catalyst One.

Uwaga: Jeśli ikona Catalyst One nie wyświetli się na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab w ciągu trzech minut, skontaktuj się z Działem Pomocy Technicznej IDEXX w celu uzyskania pomocy.

Materiały eksploatacyjne analizatora Catalyst One

Dostępne są następujące materiały eksploatacyjne, których można używać z analizatorem Catalyst One:

zestawy typu CLIP, panele i slajdy.

Każdy ze slajdów IDEXX można przeanalizować dla dowolnego gatunku, niemniej w niektórych przypadkach zakresy referencyjne mogą nie być dostępne (więcej informacji – patrz przypisy).

Badanie biochemiczne	Skrót	Chem 17 CLIP	Chem 15 CLIP	Chem 10 CLIP	Equine 15 CLIP	NSAID 6 CLIP	Panel UPC [†]	Lyte 4 CLIP	QC CLIP	Pojedyncze slajdy
Albuminy	ALB	✓	✓	✓	✓				✓	✓
Fosfatazy alkalicznej	ALKP	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Aminotransferaza alaninowa	ALT	✓	✓	✓		✓			✓	✓
Amylaza	AMYL	✓								✓
Aminotransferazy asparaginianowej	AST				✓	✓				✓
Kwasy żółciowe [†]	BA									✓
Azot mocznikowy we krwi	BUN	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Wapń	Ca	✓	✓		✓				✓	✓
Cholesterol	CHOL	✓	✓							✓
Kinaza kreatynowa	CK				✓					✓
Kreatynina	CREA	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Chlorki	Cl							✓		
Białko C-reaktywne [‡]	CRP									✓
Fruktozamina [†]	FRU									✓
Gamma-glutamylotransferazy	GGT	✓	✓		✓					✓
Glukoza	GLU	✓	✓	✓	✓				✓	✓
Potas	K							✓		
Mleczany	LAC									✓
Dehydrogenaza mleczanowa	LDH				✓					✓
Lipaza	LIPA	✓								✓
Magnez	Mg									✓
Sód	Na							✓		
Amoniak	NH ₃								✓	✓
Fenobarbital [†]	PHBR									✓
Fosforany nieorganiczne	PHOS	✓	✓							✓
Progesteron [‡]	PROG									✓
Symetryczna dimetyloarginina [†]	SDMA									✓
Bilirubina całkowita	TBIL	✓	✓		✓					✓
Białko całkowite	TP	✓	✓	✓	✓					✓
Całkowita T ₄ [†]	TT4									✓
Trójglicerydy	TRIG									✓

Badanie biochemiczne	Skrót	Chem 17 CLIP	Chem 15 CLIP	Chem 10 CLIP	Equine 15 CLIP	NSAID 6 CLIP	Panel UPC [†]	Lyte 4 CLIP	QC CLIP	Pojedyncze slajdy
Kreatynina w moczu	UCRE						✓			
Białko w moczu	UPRO						✓			
Kwas moczowy	URIC									✓

[†]Nie są dostępne zwalidowane zakresy referencyjne dla koni i „innych” gatunków.

[†]Nie są dostępne zwalidowane zakresy referencyjne dla kotów, koni i „innych” gatunków.

Kompatybilne gatunki

Gatunki, dla których określono swoiste zakresy referencyjne:

Pies [†]	Bydło
Kot [†]	Lama
Koń [†]	Żółw morski

[†]Dla tych gatunków dostępne są zakresy referencyjne. Wszystkie pozostałe gatunki zakwalifikowano jako „Inne”.

Grupy gatunków, dla których dostępne są wytyczne dotyczące zakresów referencyjnych:

Uwaga: Wytyczne dotyczące zakresów referencyjnych mogą się różnić ze względu na różnorodność gatunków w obrębie grup.

Ptak	Małpa	Szczur
Fretka	Mysz	Owca
Koza	Świnia	Wąż
Jaszczurka	Królik	Żółw

Używanie analizatora Catalyst One*

Analiza próbek

Analizę próbki w analizatorze Catalyst One* można przeprowadzić w oparciu o cztery różne przebiegi pracy:

- **Przycisk Analyze Sample** (Analizuj próbkę)—Używaj tego przebiegu pracy, jeśli **nie posiadasz** systemu zarządzania praktyką połączonego ze stacją IDEXX VetLab* za pomocą technologii SmartLink* albo IDEXX InterLink*.
- **Pending List** (Lista oczekujących) albo **Census List** (Spis)—Użyj jednego z tych przebiegów pracy, jeśli **posiadasz** system zarządzania praktyką połączony ze stacją IDEXX VetLab za pomocą technologii SmartLink albo IDEXX InterLink. Użycie tego przebiegu pracy pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie wymaga wprowadzania danych klienta ani pacjenta do stacji IDEXX VetLab (ponieważ zostały one już wprowadzone do systemu zarządzania praktyką).
- **Ikona Ready to Run** (Gotowy do pracy)—Używaj tego przebiegu pracy, jeśli analizę próbki rozpoczęto według innego przebiegu pracy, ale analizator był w tym czasie zajęty i próbka nie mogła zostać zbadana od razu.

Więcej informacji na temat tych przebiegów pracy znajduje się w *Instrukcji obsługi Stacji IDEXX VetLab*.

Praca ze slajdami

Analizator Catalyst One umożliwia przeprowadzenie maksymalnie 25 badań jednej próbki. Przed rozpoczęciem należy uwzględnić następujące kwestie:

- w analizatorze Catalyst One można badać zamrożone zestawy typu CLIP/panele/slajdy (bez konieczności rozmrażania);
- większość zestawów typu CLIP/slajdów należy załadować w ciągu pięciu minut od otwarcia ich opakowania foliowego; zestaw Lyte 4 CLIP należy załadować w ciągu dwóch minut od otwarcia opakowania foliowego;
- w przypadku analizy Lyte 4 CLIP należy umieścić zestaw w szufladzie na próbki przed umieszczeniem w niej jakichkolwiek innych zestawów typu CLIP albo slajdów;
- Aby uzyskać optymalny czas uzyskania wyników dla SDMA, zalecaną kolejnością ładowania jest Lyte 4 CLIP na dole, a następnie test chemiczny CLIP (np. Chem 17, Chem 10 itp.), SDMA, wszelkie dodatkowe preparaty i TT₄ u góry.

Rozcieńczanie próbek

Rozcieńczanie należy przeprowadzać wyłącznie w przypadku, gdy wynik badania znajduje się poza zakresem pomiaru albo gdy próbka zawiera substancje interferujące (np. leki), co powoduje wyjście poza zakres liniowości metody oznaczenia, lub wynik niepoprawny. Analizator Catalyst One umożliwia automatyczne rozcieńczanie próbek (analizator sam miesza próbkę i rozcieńczalnik) oraz ręcznie rozcieńczanie próbek (rozcieńczenia należy przeprowadzić poza analizatorem). Aby rozpocząć rozcieńczanie, na ekranie Select Instruments (Wybierz urządzenia) naciśnij ikonę analizatora Catalyst One, a następnie naciśnij Run Dilution (Uruchom rozcieńczanie).

W przypadku rozcieńczania próbek do badań w analizatorze Catalyst One należy pamiętać o następujących kwestiach:

- należy rozcieńczać wyłącznie próbki, w przypadku których uzyskano wyniki poza zakresem pomiaru. Rozcieńczanie próbek, w przypadku których uzyskano wyniki mieszczące się w zakresie wartości prawidłowych, może skutkować uzyskaniem nieważnych wyników;

- wszystkie analizy biochemiczne należy w pierwszej kolejności przeprowadzić z wykorzystaniem nierozcieńczonej próbki. Stężenie w surowicy/osoczu niektórych substancji badanych, takich jak GGT albo bilirubina całkowita, jest niskie. Te anality mogą być rozcieńczone przy zastosowaniu najmniejszej porcji rozcieńczalnika. Rozcieńcz pozostałą próbkę i powtórz wszystkie badania biochemiczne, których wyniki wykraczały poza zakres pomiaru podczas pierwszej analizy;
- wykonaj rozcieńczenie wyłącznie w sytuacji, gdy wynik badania został oznaczony symbolem większości (>) albo gdy na analizatorze pojawiła się informacja o konieczności wykonania rozcieńczenia dla uzyskania dokładnych wyników;
- używaj materiałów do rozcieńczania odpowiednich dla danego rodzaju próbki:
 - w przypadku próbek osocza albo surowicy używaj fizjologicznego roztworu soli;
 - IDEXX nie zaleca ręcznego rozcieńczania krwi pełnej w separatorze krwi pełnej Catalyst* – rozcieńczaj wyłącznie oddzielone osocze;
 - w przypadku moczu używaj rozcieńczalnika UPC Catalyst*;
- używaj dokładnego dozownika, takiego jak skalibrowana pipeta albo strzykawka;
- w celu uzyskania najlepszych wyników zacznij od rozcieńczenia w stosunku 1:2 (jedna część próbki i jedna część rozcieńczalnika) – nie należy przekraczać dziewięciu części rozcieńczalnika;
- nie należy wykonywać rozcieńczenia ręcznego ani automatycznego w przypadku badań elektrolitów, NH₃, PHBR, TT₄, SDMA, FRU, BA ani PROG, jak również w przypadku próbek krwi pełnej;
- nie należy rozcieńczać małych próbek w celu uzyskania minimalnej objętości próbki. Takie rozcieńczenia w przypadku substancji badanej, której stężenie mieści się w zakresie normy, nie zostaną dokładnie oznaczone. Jeśli rozcieńczenie jest konieczne do oznaczenia substancji badanej o bardzo wysokim stężeniu, rozcieńczenie próbki należy wykonać ręcznie;
- analiza próbek rozcieńczanych automatycznie zostanie anulowana w przypadku:
 - niedostatecznej objętości rozcieńczalnika/próbki;
 - zbyt wielu analizowanych slajdów.

Minimalna objętość próbki do rozcieńczenia

Minimalna objętość próbki różni się w zależności od współczynnika rozcieńczenia oraz liczby slajdów poddawanych rozcieńczeniu (patrz tabela poniżej).

Części próbki + części rozcieńczalnika = współczynnik rozcieńczenia	Maksymalna liczba slajdów na rozcieńczenie	Minimalna objętość próbki		Objętość rozcieńczalnika
		Surowica, osocze albo mocz	Krew pełna	
1 + 1 = 1:2	5	155 µl	700 µl	300 µl
1 + 3 = 1:4	10	130 µl	700 µl	300 µl
1 + 5 = 1:6	10	130 µl	700 µl	300 µl
1 + 9 = 1:10	10	100 µl	700 µl	300 µl

Przygotowywanie rozcieńczeń ręcznych

Przygotowanie rozcieńczenia w stosunku 1:2

1. Dokładnie odmierz żadaną objętość rozcieńczanego materiału i delikatnie przenieś do pojemnika na próbkę.
2. Dokładnie odmierz taką samą ilość rozcieńczalnika i przenieś ją do próbki pobranej w kroku 1.
3. Dokładnie wymieszaj próbkę i rozcieńczalnik.
4. Poddaj próbkę analizie.

Przygotowywanie rozcieńczeń większych niż 1:2

Jeśli konieczne jest przygotowanie rozcieńczeń większych od 1:2, należy zawsze rozpocząć ich wykonanie od oryginalnej, nierozcieńczonej próbki. Następnie należy stopniowo zwiększać liczbę części rozcieńczalnika zgodnie z tabelą rozcieńczeń (poniżej).

Objętości mają charakter wyłącznie przykładowy. Części próbki + części rozcieńczalnika = łączna liczba części (współczynnik rozcieńczenia)

Części próbki	Części rozcieńczalnika	Łączna liczba części (współczynnik rozcieńczenia)
1 (100 µl)	0	1 (nierozcieńczona próbka)
1 (100 µl)	1 (100 µl)	2
1 (100 µl)	2 (200 µl)	3
1 (100 µl)	3 (300 µl)	4
1 (100 µl)	4 (400 µl)	5
1 (100 µl)	5 (500 µl)	6
1 (100 µl)	6 (600 µl)	7
1 (100 µl)	7 (700 µl)	8
1 (100 µl)	8 (800 µl)	9
1 (100 µl)	9 (900 µl)	10

Przeglądanie i drukowanie wyników badań

Wyniki uzyskane w analizatorze są automatycznie odsyłane do stacji IDEXX VetLab i zapisywane w dokumentacji odpowiedniego pacjenta. Raport z wyników diagnostycznych jest kompleksowym raportem zawierającym wszystkie wyniki badań wyszczególnione na zleceniu odnośnie danego pacjenta w określonym dniu.

Wyniki badań pacjenta można wydrukować automatycznie za każdym razem po przesłaniu zestawu wyników albo wydrukować wyniki ręcznie w razie potrzeby.

Więcej informacji na temat przeglądania i drukowania wyników badań – patrz *Instrukcji obsługi Stacji IDEXX VetLab*.

Próbki poza liniowością zakresu

Wyniki badania mogą niekiedy wykraczać poza zakres zdolności pomiarowej analizatora. Wynik badania może być wyższy niż („>”) zakres pomiaru albo substancje zakłócające znajdujące się w próbce mogą powodować uzyskanie nieliniowego albo nieważnego wyniku. Zakresy pomiaru poszczególnych parametrów biochemicznych przedstawiono w tabeli poniżej. Jeśli uzyskanie wartości jest wymagane, konieczne będzie rozcieńczenie próbki i powtórzenie badania.

Badanie biochemiczne	Jednostki stosowane w USA	Jednostki w układzie S.I.	Jednostki stosowane we Francji
ALB	0,1-6,0 g/dl	1-60 g/l	1-60 g/l
ALKP	10-2 000 U/l	10-2 000 U/l	10-2 000 U/l
ALT	10-1 000 U/l	10-1 000 U/l	10-1 000 U/l
AMYL	5-2 500 U/l	5-2 500 U/l	5-2 500 U/l
AST	0-1 083 U/l	0-1 083 U/l	0-1 083 U/l
BA	1,0–180,0 µmol/l	1,0–180,0 µmol/l	1,0–180,0 µmol/l
BUN/UREA	2-130 mg/dl	0,6-46,4 mmol/l	0,034-2,730 g/l
Ca	1,0-16,0 mg/dl	0,25-4,00 mmol/l	10-160 mg/l
CHOL	6-520 mg/dl	0,16-13,44 mmol/l	0,06-5,20 g/l
CK	10-2 036 U/l	10-2 036 U/l	10-2 036 U/l
Cl ⁺	50-160 mmol/l	50-160 mmol/l	50-160 mmol/l
CREA	0,1-13,6 mg/dl	9-1202 µmol/l	1,0-136,0 mg/l
CRP	0,1-10,0 mg/dl	1,0-100,0 mg/l	1,0-100,0 mg/l
FRU [†]	100-1 000 µmol/l	100-1 000 µmol/l	100-1 000 µmol/l
GGT	0-952 U/l	0-952 U/l	0-952 U/l
GLU	10-686 mg/dl	0,56-38,11 mmol/l	0,10-6,86 g/l
K ⁺	0,8-10 mmol/l	0,8-10 mmol/l	0,8-10,0 mmol/l
LAC	0,50-12,00 mmol/l	0,50-12,00 mmol/l	0,50-12,00 mmol/l
LDH	50-2 800 U/l	50-2 800 U/l	50-2 800 U/l
LIPA	10-6 000 U/l	10-6 000 U/l	10-6 000 U/l
Mg	0,5-5,2 mg/dl	0,21-2,17 mmol/l	5,0-52,0 mg/l
Na ⁺	85-180 mmol/l	85-180 mmol/l	85-180 mmol/l
NH ₃ [†]	0-950 µmol/l	0-950 µmol/l	0-950 µmol/l
PHBR ^{††}	5-55 µg/ml	5-55 µg/ml	5-55 µg/ml
PHOS	0,2-16,1 mg/dl	0,06-5,19 mmol/l	2,00-161,00 mg/l
PROG [†]	0,2-20,0 ng/ml	0,6-63,6 nmol/l	0,2-20,0 ng/ml
SDMA [†]	0-100 µg/dl	0-100 µg/dl	0-100 µg/dl
TBIL	0,1-27,9 mg/dl	2-477 µmol/l	1,0-279,0 mg/l
TP	0,5-12,0 g/dl	5-120 g/l	5-120 g/l
TRIG	10-375 mg/dl	0,11-4,23 mmol/l	0,10-3,75 g/l
TT ₄ (pies) [†]	0,5-10,0 µg/dl	6,43-128,70 nmol/l	6,43-128,70 nmol/l
TT ₄ (kot) [†]	0,5-20,0 µg/dl	6,4-257,4 nmol/l	6,4-257,4 nmol/l
UCRE	6-350 mg/dl	0,06-3,50 g/l	0,06-3,50 g/l
UPRO	5-400 mg/dl	0,05-4,00 g/l	0,05-4,00 g/l
URIC	0,1-20 mg/dl	6-1 190 µmol/l	1-200 mg/l

[†] 1 µg/ml = 4,31 µmol/l

^{††} Wskazuje rodzaje próbek, których nie należy rozcieńczać.

Modyfikowanie ustawień analizatora

Modyfikowanie ustawień dźwięku[†]

Analizator zasygnalizuje dźwiękowo, gdy pojawi się nowe powiadomienie. Można modyfikować ustawienia dźwięku w celu wyłączenia dźwięku albo dostosowania jego głośności.

1. Na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab naciśnij **Instruments** (Przyrządy).
2. Wybierz zakładkę **Catalyst One**.
3. Aby całkowicie wyłączyć dźwięki analizatora, naciśnij **Off** (Wyłącz) w obszarze ustawień Sound (Dźwięk).
ALBO
4. Aby ustawić niską głośność dźwięku, naciśnij **Low** (Niska) w obszarze ustawień Sound (Dźwięk).
ALBO
5. Aby ustawić wysoką głośność dźwięku, naciśnij **High** (Wysoka) w obszarze ustawień Sound (Dźwięk).

Przechodzenie w tryb czuwania

Można zmodyfikować ustawienia analizatora w taki sposób, aby przechodził w tryb czuwania codziennie o określonej porze albo natychmiastowo przełączać go w tryb czuwania.

1. Na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab naciśnij **Instruments** (Przyrządy).
2. Wybierz zakładkę **Catalyst One**.
3. Aby całkowicie wyłączyć możliwość przechodzenia analizatora w tryb czuwania, naciśnij **Never** (Nigdy) w obszarze ustawień Standby (Tryb czuwania).
ALBO
4. Aby zaplanować przechodzenie analizatora w tryb czuwania o określonej porze dnia, naciśnij **Daily** (Codziennie) w obszarze ustawień Standby (Tryb czuwania), a następnie wybierz pożądaną godzinę rozpoczęcia z dostępnej listy rozwijanej.
ALBO
5. Aby włączyć natychmiastowe przejście analizatora w tryb czuwania, naciśnij **Now** (Teraz) w obszarze ustawień Standby (Tryb czuwania).

Wychodzenie z trybu czuwania

Można ustawić analizator w taki sposób, aby wychodził z trybu czuwania o konkretnej porze dnia albo natychmiastowo.

1. Na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab naciśnij **Instruments** (Przyrządy).
2. Wybierz zakładkę **Catalyst One**.
3. Aby zaplanować wychodzenie analizatora z trybu czuwania o określonej porze dnia, naciśnij **Daily** (Codziennie) w obszarze ustawień Exit Standby (Koniec trybu czuwania), a następnie wybierz pożądaną godzinę rozpoczęcia z dostępnej listy rozwijanej.
ALBO
4. Aby włączyć natychmiastowe wyjście analizatora z trybu czuwania, naciśnij **Now** (Teraz) w obszarze ustawień Exit Standby (Koniec trybu czuwania).

[†]Funkcja dostępna wkrótce

Przygotowanie i przechowywanie próbek

Obsługiwane rodzaje próbek dla zestawów typu CLIP i slajdów Catalyst*

Przy użyciu zestawów typu CLIP i slajdów Catalyst* mogą być badane następujące rodzaje próbek:

Zestawy typu CLIP/slajdy	Skrót	Surowica	Osocze z heparyną litową	Osocze z fluorkiem/szczawianem	Krew pełna niepoddana obróbce (przy użyciu separatora krwi pełnej Catalyst* Lithium)	Mocz
Chem 17 CLIP	ND.	✓	✓		✓	
Chem 15 CLIP	ND.	✓	✓		✓	
Chem 10 CLIP	ND.	✓	✓		✓	
Equine 15 CLIP	ND.	✓	✓		✓	
NSAID 6 CLIP	ND.	✓	✓		✓	
Panel UPC	ND.					✓
Lyte 4 CLIP	ND.	✓	✓		✓	
Albuminy	ALB	✓	✓		✓	
Fosfatazy alkalicznej	ALKP	✓	✓		✓	
Aminotransferaza alaninowa	ALT	✓	✓		✓	
Amylaza	AMYL	✓	✓		✓	
Aminotransferazy asparaginianowej	AST	✓	✓		✓	
Kwasy żółciowe	BA	✓	✓		✓	
Azot mocznikowy we krwi	BUN/UREA	✓	✓		✓	
Wapń	Ca	✓	✓		✓	
Cholesterol	CHOL	✓	✓		✓	
Kinaza kreatynowa	CK	✓	✓		✓	
Kreatynina	CREA	✓	✓		✓	
Białko C-reaktywne	CRP	✓	✓		✓	
Fruktozamina	FRU	✓	✓		✓	
Gamma-glutamylotransferazy	GGT	✓	✓		✓	
Glukoza	GLU	✓	✓	✓	✓	
Mleczany	LAC		✓	✓	✓	
Dehydrogenaza mleczanowa	LDH	✓	✓		✓	
Lipaza	LIPA	✓	✓		✓	
Magnez	Mg	✓	✓		✓	
Amoniak	NH ₃		✓		✓	
Fenobarbital	PHBR	✓	✓		✓	
Fosforany nieorganiczne	PHOS	✓	✓		✓	
Progesteron	PROG	✓	✓		✓	
Symetryczna dimetyloarginina	SDMA	✓	✓		✓	

Zestawy typu CLIP/slajdy	Skrót	Surowica	Osocze z heparyną litową	Osocze z fluorkiem/szczawianem	Krew pełna niepoddana obróbce (przy użyciu separatora krwi pełnej Catalyst* Lithium)	Mocz
Bilirubina całkowita	TBIL	✓	✓		✓	
Białko całkowite	TP	✓	✓		✓	
Całkowita T ₄	TT ₄	✓	✓		✓	
Trójglicerydy	TRIG	✓	✓		✓	
Kwas moczowy	URIC	✓	✓		✓	

Przygotowanie próbek do badania w analizatorze Catalyst One

W analizatorze Catalyst One można zbadać próbki krwi pełnej niepoddanej obróbce, krwi pełnej pobranej na heparynę litową, osocza, surowicy oraz moczu.

WAŻNE: W przypadku badań biochemicznych nie należy używać EDTA ani heparyny sodowej.

Przygotowanie próbki krwi pełnej niepoddanej obróbce

(przy użyciu separatora krwi pełnej z heparyną litową)

1. Zdejmij zielony korek z separatora krwi pełnej, aby przygotować go do napełnienia próbka krwi.
2. **Natychmiast** po pobraniu próbki (aby uniknąć powstania skrzepów) wstrzyknij 0,6–0,8 ml **niepoddanej obróbce** (niezawierającej dodatków) krwi pełnej do separatora krwi pełnej z heparyną litową za pomocą niepoddanej obróbce strzykawki bez igły.

Wskazówka: Korzystaj z zaznaczonej na separatorze kreski pomiarowej, do której należy wypełnić separator, aby osiągnąć wymaganą objętość próby.

Uwaga: Próbki heparynizowane mogą zostać umieszczone w separatorze z heparyną litową z *wyjątkiem* analiz AST, LDH i CK wykonywanych w przypadku kotów. Podwójne dawkowanie w przypadku próbek pobranych od kotów może skutkować zawyżeniem wyników tych oznaczeń.

3. Delikatnie zamieszaj ruchem wirowym (**nie odwracaj ani nie wstrząsaj**) separatorem krwi pełnej co najmniej pięć razy w celu wymieszania próbki z antykoagulantem.

Uwaga: Przed włożeniem separatora do analizatora upewnij się, że korek został zdjęty.




Przygotowanie próbki osocza

1. Użyj odpowiedniej probówki i zestawu do pobierania.
2. Ostrożnie pobierz próbkę i przenieś ją, jeśli jest to konieczne.

Uwaga: Upewnij się, że zastosowany stosunek krwi do heparyny litowej jest prawidłowy.

3. Delikatnie odwracaj (nie wstrząsaj) próbkę przez 30 sekund w celu jej wymieszania.
4. Jak najszybciej (w ciągu 30 minut od pobrania) odwiruj próbkę korzystając z odpowiednich ustawień (ustawienia i czas wirowania sprawdź w instrukcji obsługi swojej wirówki).

- Bezpośrednio po odwirowaniu użyj pipety do przenoszenia (albo pipety 300 μ l), aby przenieść odpowiednią objętość próbki do pojemnika na próbki Catalyst (upewnij się, że w pojemniku na próbki nie ma pęcherzyków oraz zachowaj szczególną ostrożność, aby nie doszło do aspiracji komórek podczas pobierania osocza). Wymagana objętość zależy od liczby analizowanych slajdów – więcej informacji znajduje się w części „Odpowiednia pojemność pojemnika na próbki” na stronie 22.

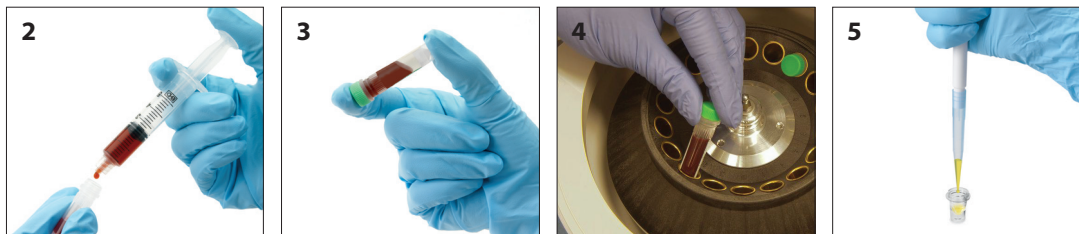


Przygotowanie próbki surowicy

- Użyj odpowiedniej probówki i zestawu do pobierania.
- Ostrożnie pobierz próbkę i przenieś ją, jeśli jest to konieczne.
- Pozostaw próbkę do wykrzepnięcia na co najmniej 20 minut.
- W ciągu 45 minut od pobrania odwirowuj próbkę (ustawienia i czas wirowania sprawdź w instrukcji obsługi swojej wirówki).
- Bezpośrednio po odwirowaniu użyj pipety do przenoszenia (albo pipety 300 μ l), aby przenieść odpowiednią ilość materiału do pojemnika na próbki Catalyst (upewnij się, że w pojemniku na próbki nie ma pęcherzyków oraz zachowaj szczególną ostrożność, aby nie naruszyć skrzepu podczas pobierania surowicy). Wymagana objętość zależy od liczby analizowanych slajdów – więcej informacji znajduje się w części „Odpowiednia pojemność pojemnika na próbki” na stronie 22.



Przygotowanie próbki moczu

- Pozyskaj próbkę metodą cystocentezy (zalecana), cewnikowania albo tzw. „łapania moczu”.
- Przenieś próbkę do jednorazowej probówki.
- Odwirowuj próbkę.
- Użyj pipety do przenoszenia (albo pipety 300 μ l), aby przenieść odpowiednią ilość supernatantu moczu do pojemnika na próbki Catalyst (upewnij się, że w pojemniku na próbki nie ma pęcherzyków). Wymagana objętość zależy od liczby analizowanych slajdów – więcej informacji znajduje się w części „Odpowiednia pojemność pojemnika na próbki” na stronie 22.

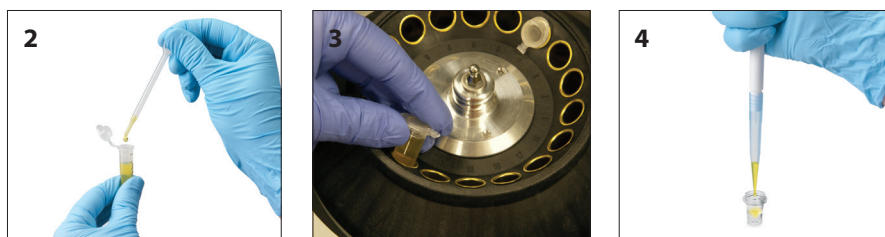

Odpowiednia pojemność pojemnika na próbki

W przypadku korzystania z pojemnika na próbki Catalyst, 300 mikrolitrów surowicy albo osocza pozwoli na wykonanie większości kombinacji badań. Poniższa tabela zawiera ogólne wskazówki dotyczące badań, które nie wymagają użycia materiałów eksploatacyjnych zawierających odczynnik. Wymagania dotyczące rodzaju i objętości próbki dla poszczególnych badań znajdują się w obowiązujących skróconych instrukcjach obsługi.

Liczba slajdów	Objętość próbki w pojemniku (µl)
1	60
2	70
3	80
4	90
5	100
6	110
7	120
8	130
9	190
10	200
11	210
12	220
13	230
14	240
15	250
16	260
17	270
18	280

Kontrola próbki po odwirowaniu

Dobłą praktyką jest ostrożne sprawdzenie próbki po odwirowaniu w wirówce lub w analizatorze (w trakcie badania przy użyciu separatora krwi pełnej). Jeśli w próbce widoczne są włókna fibryny, mogą one wpłynąć na zasysanie próbki. Może być konieczne zerbanie ich z surowicy/osocza przy pomocy drewnianego patyczka. Następnie należy ponownie odwirować próbkę i można kontynuować badanie.

Różne okoliczności, takie jak hemoliza, mogą wpłynąć na wyniki. Można również zmodyfikować panel badań na podstawie obserwacji wzrokowych. Informacje dotyczące wpływu wszystkich czynników na poszczególne badania biochemiczne znajdują się w części „Opisy badań biochemicznych” na stronach 31-61.

Uwaga: W przypadku korzystania z separatora krwi pełnej Catalyst zaleca się sprawdzenie próbki po wykonaniu analizy pod kątem artefaktów wymienionych poniżej i odpowiednią interpretację wyników.

Hemoliza

Wygląd: próbka ma przejrzysty czerwony kolor, od bladego różowego do głębokiej czerwieni.

Możliwa przyczyna: uszkodzenie czerwonych krwinek podczas przygotowywania próbki albo hemoliza wewnątrz naczyń.

Żółtaczka

Wygląd: osocze ma kolor od przejrzystego żółtego do nieprzezroczystego brązowego.

Możliwa przyczyna: obturacyjna albo toksyczna choroba wątroby, hemoliza wewnątrznaczyniowa.

Lipemia

Wygląd: próbka ma jasny, mleczny wygląd; na powierzchni mogą unosić się skupiska tłuszczu.

Możliwa przyczyna: niedawne spożycie tłustego posiłku albo zaburzenie metabolizmu lipidów.

Przechowywanie próbek

W celu uzyskania jak najwyższej jakości wyników badań, zalecamy niezwłoczne przygotowanie i analizę próbki po jej pobraniu. Jeżeli jednak przechowywanie jest konieczne, zastosuj się do poniższych wytycznych dotyczących przechowywania i analizowania próbek.

Przechowywanie surowicy/osocza

Na potrzeby przechowywania należy natychmiast oddzielić surowicę albo osocze od komórek krwi. Nie należy podejmować próby ulania próbki.

- Za pomocą pipety do przenoszenia ostrożnie przenieś surowicę albo osocze do czystej (bez antykoagulantu) probówki do pobierania próbek, starając się nie pobrać żadnych białych ani czerwonych krwinek.
- Szczelnie zamknij probówkę korkiem, aby uniknąć zanieczyszczenia i odparowania. Unikaj spienienia próbki na każdym etapie przygotowania. Spienienie próbki może powodować uszkodzenia białek zawartych w surowicy.

Jeśli wykonanie analizy nie jest możliwe w ciągu czterech godzin od pobrania i przetworzenia próbki należy natychmiast po przygotowaniu schłodzić próbkę w temperaturze 2°C–8°C. Jeśli wykonanie analizy schłodzonej próbki w ciągu 48 godzin nie jest możliwe, należy zamrozić surowicę/osocze w temperaturze -18°C. Surowicę/osocze można zamrozić natychmiast po przygotowaniu i przechowywać przez maksymalnie jeden miesiąc.

Uwagi:

- Dodatkowe informacje dotyczące wpływu późniejszego oddzielenia surowicy albo osocza od komórek znajdują się w części „Opisy badań biochemicznych” na stronach 31-61.
- W opisach badań biochemicznych polegających na oznaczaniu stężenia wapnia (Ca), bilirubiny całkowitej (TBIL), dehydrogenazy mleczanowej (LDH), amoniaku (NH₃), elektrolitów (Na, K, Cl) oraz glukozy (GLU) znajdują się informacje na temat dodatkowych szczególnych wymogów dotyczących postępowania z próbkami i ich przechowywania.
- IDEXX nie zaleca zamrażania próbek, które będą wykorzystywane do analizy elektrolitów, PROG, TT₄, SDMA, BA albo NH₃.

Przechowywanie krwi pełnej

Próbki krwi pełnej z heparyną litową należy niezwłocznie poddać analizie. Próbki, które nie zostaną poddane analizie w ciągu 30 minut, należy umieścić w probówkach, w których zostaną odwirowane i będą przechowywane (patrz instrukcje powyżej).

Ważne: Nie należy przechowywać próbek krwi pełnej w separatorach krwi pełnej.

Przechowywanie moczu

Próbki moczu należy poddać analizie w ciągu dwóch godzin. Nie należy przechowywać moczu w lodówce dłużej niż 24 godziny. Moczu nie należy przechowywać w zamrażarce.

Analiza przechowywanych próbek

W przypadku próbek przechowywanych w temperaturze 2°C–8°C i w temperaturze -18°C:

- pozostaw próbki do osiągnięcia temperatury pokojowej (19°C–27°C);
- wymieszaj próbki delikatnie, ale dokładnie, poprzez odwracanie. nie wstrząsaj;
- odwirowuj próbki w celu usunięcia ewentualnych cząsteczek fibryny (albo osadu moczu), które mogły się utworzyć podczas przechowywania;
- poddaj próbkę analizie bezpośrednio po odwirowaniu.

Kontrola jakości

Informacje ogólne

Celem kontroli jakości (quality control, QC) jest sprawdzenie integralności slajdów oraz prawidłowego działania analizatora Catalyst One*.

Test kontroli jakości należy przeprowadzić:

- przy pierwszym montażu analizatora;
- po czyszczeniu elementów wewnętrznych analizatora;
- jeśli analizator został przeniesiony;
- w celu sprawdzenia działania systemu.

Materiały kontroli jakości

Próbka kontrolna VetTrol*

W każdym opakowaniu próbki kontrolnej VetTrol* znajdują się cztery fiołki z proszkiem poddanym suszeniu sublimacyjnemu (ciemnobrązowa butelka oznaczona „próbka kontrolna VetTrol”) oraz cztery fiołki z rozcieńczalnikiem (jaśniejsze butelki oznaczone „Rozcieńczalnik VetTrol”). Numery serii rozcieńczalnika i próbki kontrolnej są różne i znajdują się na opakowaniach produktów.

Dodatkowe informacje na temat próbki kontrolnej VetTrol znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie

Fiołki z próbką kontrolną i rozcieńczalnikiem należy przechowywać zamrożone (-18°C). Otwarte fiołki z próbką kontrolną należy zutylizować w ciągu 24 godzin. Materiały przeterminowane albo niepotrzebne należy zutylizować wraz z innymi odpadami medycznymi.

Uwaga: Przechowywać wyłącznie w głównej komorze zamrażarki. Nie przechowywać na drzwiach zamrażarki.

Stabilność i postępowanie

W przypadku większości badań biochemicznych próbkę kontrolną VetTrol można wykorzystać w ciągu 24 godzin po przygotowaniu, jeżeli jest przechowywana w lodówce i ogrzana w temperaturze pokojowej przed analizą (nie należy przechowywać przygotowanej surowicy kontrolnej w temperaturze pokojowej dłużej niż dwie godziny). W przypadku analizowania wartości kinazy kreatynowej i amoniaku płyn kontrolny VetTrol należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu. Ekspozycja na światło ma wpływ na wyniki oznaczenia bilirubiny całkowitej i kinazy kreatynowej. Stężenie amoniaku wzrasta z upływem czasu.

Próbka kontrolna UPRO

W każdym opakowaniu próbek kontrolnych UPRO znajduje się sześć fiołek zawierających płyn kontrolny. Numer serii znajduje się na opakowaniu produktu.

Przechowywanie

Płyn kontrolny należy przechowywać w lodówce (2°C–8°C). Zutylizować po upływie daty ważności. Materiały przeterminowane albo niepotrzebne należy zutylizować wraz z innymi odpadami medycznymi.

Stabilność i postępowanie

Zużyć w ciągu 24 godzin po otwarciu (przechowywać w lodówce, jeśli nie jest używany).

Próbka kontrolna Advanced

W każdym opakowaniu próbki kontrolnej Advanced znajduje się jedna fiolka zawierająca płyn kontrolny. Numer serii znajduje się na opakowaniu produktu.

Uwaga: Każda fiolka zawiera ilość płynu wystarczającą do dwóch analiz, na wypadek gdyby druga analiza okazała się konieczna.

Przechowywanie

Przechowywać w stanie zamrożonym do upływu daty ważności albo przechowywać w lodówce przez maksymalnie pięć dni.

Stabilność i postępowanie

Po otwarciu próbki kontrolnej Advanced nie wolno jej przechowywać ani wykorzystywać ponownie – po użyciu zutylizuj pozostałości płynu.

Kontrola PHBR

W każdym opakowaniu próbek kontrolnych PHBR znajduje się sześć fiolek zawierających płyn kontrolny. Numer serii znajduje się na opakowaniu produktu.

Przechowywanie

Przechowywać w stanie zamrożonym do upływu daty ważności albo przechowywać w lodówce przez maksymalnie siedem dni.

Stabilność i postępowanie

Po jednorazowym rozmrożeniu próbki kontrolnej PHBR nie można ponownie jej przechowywać. Raz przygotowany roztwór nie należy ponownie wykorzystywać- po użyciu należy zutylizować pozostałości płynu.

Zestaw slajdów do kontroli jakości (Catalyst QC CLIP)

IDEXX zaleca wykonywanie testu kontroli jakości raz na miesiąc po wyczyszczeniu elementów wewnętrznych analizatora. Wygodne zestawy Catalyst* QC CLIP zawierają wszystkie slajdy do badań biochemicznych potrzebne do wykonania tego zadania. Zaleca się również wykonanie kontroli jakości elektrolitów za pomocą zestawu Catalyst* Lyte 4 CLIP.

Analiza z wykorzystaniem zestawów QC CLIP i Lyte 4 CLIP

Wykonaj kontrolę jakości w analizatorze Catalyst One za pomocą wygodnych zestawów QC CLIP, Lyte 4 CLIP oraz płyn kontrolny VetTrol. Po wykonaniu analizy dowolnych slajdów zaleca się odczekanie co najmniej 30 minut przed wykonaniem analizy QC CLIP.

ALBO

Analiza z wykorzystaniem pojedynczych slajdów

Można użyć pojedynczych slajdów do stworzenia własnego panelu QC i wykonania testu kontroli jakości (jeden slajd na grupę). W przypadku przeprowadzania kontroli jakości przy użyciu pojedynczych slajdów zaleca się użycie co najmniej jednego slajdu z każdej z poniższych grup.

Grupa 1	NH ₃
Grupa 2	AMYL
	CHOL
	GLU
	LAC
	LIPA
	TBIL
	TP
	TRIG

Grupa 3	ALB CREA Mg PHOS BUN/UREA URIC UCRE
Grupa 4	ALT LDH
Grupa 5	ALKP GGT
Grupa 6	AST Ca CK UPRO (używać wyłącznie z płyn kontrolny UPRO)

Przygotowywanie płyn kontrolny

Instrukcje przygotowania płyn kontrolny różnią się w zależności od rodzaju przygotowywanej próbki kontrolnej.

Przygotowanie płyn kontrolny VetTrol

1. Wymij jedną fiolkę z rozcieńczalnikiem i jedną fiolkę z próbką kontrolną z zamrażarki. Pozostaw fiolki na 60–90 minut do zrównoważenia w temperaturze pokojowej.
2. W celu dokładnego wymieszania zawartości fiolki z rozcieńczalnikiem należy kilka razy powoli odwrócić fiolkę z rozcieńczalnikiem lub umieścić ją na kołysce do probówek. Nie wstrząsać.
3. Delikatnie stuknij kilka razy fiolką z próbką kontrolną o blat w celu przemieszczenia ewentualnego materiału przylegającego do korka.
4. Zdejmij uszczelkę i korek z każdej fiolki bezpośrednio przed dodaniem rozcieńczalnika do próbki kontrolnej. Nie pozostawiaj otwartych fiolek.
5. Przenieś dokładnie 3,0 ml rozcieńczalnika do fiolki z próbką kontrolną za pomocą czystej, suchej pipety miarowej klasy A albo równoważnej pipety automatycznej. Zutylicuj pozostałości rozcieńczalnika.

WAŻNE: Należy precyzyjnie odmierzyć objętość. W przeciwnym razie wyniki będą nieprawidłowe.

Uwaga: W przypadku używania strzykawki należy zdjąć z niej igłę.

6. Załóż z powrotem korek na fiolkę z próbką kontrolną i przytrzymaj go mocno na miejscu. Ostrożnie odwracaj fiolkę 6–10 razy co 10 minut przez **jedną godzinę** (zaleca się używanie kołyski laboratoryjnej ustawionej na niską częstotliwość mieszania). nie wstrząsaj; Rekonstrukcja z okresowym odwracaniem zajmie **45–60 minut**. Przed użyciem oceń wizualnie, czy cały materiał poddany suszeniu sublimacyjnemu uległ rozpuszczeniu.
7. Przeprowadź kontrolę jakości w analizatorze Catalyst One (patrz instrukcje poniżej).

Przygotowanie płyn kontrolny UPRO

1. Wymij jedną fiolkę z próbką kontrolną UPRO z lodówki i delikatnie odwróć ją 6–10 razy w celu dokładnego wymieszania.
2. Przenieś 300 µl próbki kontrolnej UPRO do pojemnika na próbki Catalyst* (który zostanie umieszczony w szufladzie na próbki).
3. Odczekaj, aż zawartość pojemnika na próbki osiągnie temperaturę pokojową (około 10 minut).
4. Uruchom kontrolę jakości w analizatorze.

Przygotowanie płyn kontrolny Advanced

1. Jeśli próbka kontrolna Advanced była zamrożona, przed użyciem pozostaw ją do rozmrożenia na 30 minut.
2. Odwróć fiolkę z próbką kontrolną Advanced co najmniej pięć razy.
3. Przenieś zawartość fiołki z próbką kontrolną Advanced do pojemnika na próbki Catalyst*.
4. Uruchom kontrolę jakości w analizatorze.

Przygotowanie płyn kontrolny PHBR

1. Wyjmij jedną fiolkę z próbką kontrolną PHBR z lodówki i odczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową (około 60 minut).
2. Po upewnieniu się, że w fiołce nie pozostał żaden widoczny zamrożony materiał, delikatnie odwróć ją 6–10 razy w celu dokładnego wymieszania.
3. Przenieś 300 µl próbki kontrolnej PHBR do pojemnika na próbki Catalyst*.
Uwaga: Do przeprowadzenia procedury kontroli jakości potrzebne będą: jedna porcja roztworu płuczącego do slajdów PHBR i jeden slajd PHBR.
4. Uruchom kontrolę jakości w analizatorze.

Uruchamianie kontroli jakości

Uruchamianie ogólnej kontroli jakości w analizatorze Catalyst One

1. Naciśnij ikonę **Catalyst One** na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab.
2. Naciśnij przycisk **Maintenance** (Konserwacja), a następnie wybierz opcję **Quality Control** (Kontrola jakości).
3. Naciśnij wykorzystywany numer serii kontroli jakości, a następnie wybierz opcję **Run QC** (Przeprowadź kontrolę jakości).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować i przeprowadzić kontrolę jakości.

Uwagi:

- Aby w dowolnym momencie przeglądać wyniki kontroli jakości, naciśnij przycisk **Maintenance** (Konserwacja), wybierz opcję **Quality Control** (Kontrola jakości), naciśnij **View QC Results** (Pokaż wyniki kontroli jakości), wybierz konkretną datę wykonania kontroli jakości, a następnie naciśnij przycisk **View Results** (Pokaż wyniki).
- Aby przeglądać oczekiwane zakresy wartości dla poszczególnych badań biochemicznych serii kontroli jakości, naciśnij przycisk **Maintenance** (Konserwacja), wybierz opcję **Quality Control** (Kontrola jakości), wybierz odpowiednią serię kontroli jakości, a następnie naciśnij przycisk **View QC Lot Information** (Pokaż informacje o serii kontroli jakości).

Konserwacja

Informacje ogólne

Oprócz wykonywania co miesiąc kontroli jakości w analizatorze Catalyst One*, zaleca się również:

- czyszczenie analizatora wewnątrz i na zewnątrz;
- aktualizowanie oprogramowania bez zbędnej zwłoki.

Aktualizowanie oprogramowania

IDEXX będzie zapewniać aktualizacje oprogramowania, gdy do analizatora Catalyst One będą dodawane nowe funkcje i funkcjonalności. W przypadku użytkowników korzystających z usługi IDEXX SmartService* Solutions aktualizacje będą przesyłane automatycznie za pośrednictwem stacji IDEXX VetLab*. Użytkownicy, którzy nie wykupili usługi IDEXX SmartService Solutions, będą otrzymywać aktualizacje pocztą elektroniczną. Należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi oprogramowania załączonymi do każdej nowej wersji.

Czyszczenie elementów wewnętrznych analizatora


W celu zapewnienia optymalnego działania analizatora ważne jest czyszczenie elementów wewnętrznych (pierścień inkubatora, okienko optyczne i karuzela) raz w miesiącu i przed przeprowadzeniem kontroli jakości.

Zaleca się noszenie czystych bezpudrowych rękawiczek lateksowych albo nitylowych podczas czyszczenia elementów wewnętrznych analizatora. Noszenie takich rękawiczek pomaga zapobiegać powstawaniu smug na elementach oraz umożliwia ich dokładne wyczyszczenie.

WAŻNE: Nigdy nie należy używać materiałów czyszczących (takich jak waciki do czyszczenia nasączone alkoholem zawierające wodorowęglan sodu), które zostawiają pozostałości po odparowaniu alkoholu/rozpuszczalnika.

Czyszczenie elementów wewnętrznych

1. Naciśnij ikonę **Catalyst One** na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab.
2. Naciśnij przycisk **Maintenance** (Konserwacja), a następnie przycisk **Clean** (Wyczyść) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - a. Otwórz boczne drzwiczki analizatora.
 - b. Podnoś pokrywę karuzeli do momentu, gdy magnes przyciągnie zieloną dźwignię do wnętrza analizatora.
 - c. Unieś karuzelę i wyjmij ją z analizatora.
 - d. Przy użyciu chusteczek nasączonych alkoholem zapewnianych przez IDEXX przetrzyj pierścień inkubatora i okienko optyczne w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Powtórz ten krok co najmniej trzy razy, za każdym razem używając nowego chusteczek nasączonych alkoholem.



- e. Wyczyść białą płytkę referencyjną używając nowego chusteczki nasączonych alkoholem.
- f. Przy użyciu suchej chusteczki do urządzeń optycznych wytrzyj do sucha okienko optyczne i płytkę referencyjną, tak aby wszelka wilgoć odparowała z czyszczonych elementów. Powtórz proces czyszczenia, jeśli pozostały smugi albo plamy.
- g. Włóż karuzelę do analizatora, opuść pokrywę karuzeli, a następnie zamknij boczne drzwiczki.
- h. Naciśnij przycisk **Gotowe**.



Czyszczenie zewnętrznych elementów analizatora i szuflady na próbki

Wyczyść zewnętrzne elementy analizatora albo szuflady na próbki wilgotną (nie mokrą) ściereczką niepozostawiającą włókien. Tłuste zabrudzenia można usunąć za pomocą delikatnego mydła w płynie. W pobliżu analizatora nie należy używać następujących produktów: rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące na bazie amoniaku, markery tuszowe, aerozole zawierające ciecze lotne, środki owadobójcze, środki dezynfekcyjne, środki nadające połysk albo odświeżacze powietrza.

Należy uważać, aby nie rozlać żadnych próbek, substancji chemicznych, środków czyszczących, wody ani innych płynów na analizator ani w jego wnętrzu.

Uwaga: Kurz i zwierzęca sierść mogą doprowadzić do awarii analizatora. Należy regularnie wycierać analizator z kurzu za pomocą wilgotnej ściereczki i ścierać kurze w jego otoczeniu. Nie należy dopuścić do zablokowania otworów wentylacyjnych znajdujących się na spodzie urządzenia przez nagromadzenie papieru, sypkich materiałów albo kurzu.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy czyścić analizatora ani jego otoczenia środkami czyszczącymi na bazie amoniaku. Należy unikać oparów moczu w pobliżu analizatora. Amoniak w powietrzu atmosferycznym będzie fałszywie podwyższał wyniki oznaczenia amoniaku (NH_3) w testach kontroli jakości i badaniach pacjentów.

Opróżnianie szuflady na odpady

Bardzo ważne jest, aby opróżnić szufladę na odpady po każdej analizie albo po wyświetleniu się monitu. W przypadku zapełnienia szuflady na odpady analizator nie będzie działać. Pociągnij szufladę na odpady, aby wyjąć ją z analizatora.

Opisy badań biochemicznych

Służąc lekarzom weterynarii na całym świecie, firma IDEXX Laboratories zdaje sobie sprawę, że treść medyczna, w tym interpretacja wyników badań diagnostycznych i protokoły medyczne, mogą się różnić w zależności od kraju. Zawartość niniejszego dokumentu została zatwierdzona przez radę weryfikacji medycznej.

IDEXX posiada ponad 40 laboratoriów referencyjnych na całym świecie, w których zatrudnia ponad 100 lekarzy weterynarii. W razie jakichkolwiek pytań związanych z treścią medyczną albo interpretacją wyników przedstawioną w niniejszym dokumencie należy skontaktować się z IDEXX Laboratories.

Wprowadzenie do profili biochemicznych

Wykonując odpowiednie badania biochemiczne przy użyciu próbek dobrej jakości można uzyskać informacje, które w połączeniu z historią choroby pacjenta i obserwacjami klinicznymi powinny pomóc w ustaleniu właściwego rozpoznania. Odpowiednie badania biochemiczne są kluczowe również w przypadku monitorowania i określenia rokowań po uzyskaniu rozpoznania.

Pojedyncze badania są pomocne w określonych sytuacjach, takich jak obserwacja przebiegu rozpoznanej choroby albo monitorowanie skuteczności leczenia. Wiele z pojedynczych badań dostarcza jednak informacji o różnych układach narządów i powinno się je wykonywać w połączeniu z innymi badaniami (panele albo profile), co pomoże scharakteryzować chorobę.

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

W praktyce w przypadku psów i kotów enzym aminotransferazy alaninowej jest swoisty dla wątroby. Jest on obecny w cytoplazmie hepatocytów i może być uwalniany do krwi w momencie powstania zarówno odwracalnych, jak i nieodwracalnych (nekroza komórek) zmian.

Główny cel wykonania badania

Zbadanie uszkodzeń komórek wątroby u psów i kotów.

Uwaga: To badanie nie jest użyteczne w wykrywaniu chorób wątroby u przeżuwaczy, koni i świń, ponieważ aktywność enzymu w wątrobach tych zwierząt jest bardzo niska. Wzrost aktywności u tych gatunków jest minimalny nawet w przypadku ciężkiej choroby wątroby.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu



Uszkodzenie komórek wątroby.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. Nie należy używać próbek zhemolizowanych, ponieważ zostaną one zanieczyszczone ALT pochodzącym z krwinek czerwonych. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.

Badania uzupełniające

Oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej wykonuje się zazwyczaj łącznie z innymi badaniami czynności wątroby albo badaniami w kierunku uszkodzeń wątroby.

Przebieg reakcji**Albumina (ALB)**

U zdrowych zwierząt albumina stanowi największą część białka całkowitego w surowicy. Jest syntetyzowana wyłącznie przez wątrobę, ma stosunkowo niską masę cząsteczkową i odgrywa ważną rolę w transporcie związków endogennych i egzogennych poprzez wiązanie tych związków. Albumina pełni również istotną rolę związaną z osmoregulacją.

Główne powody wykonania badania

Zbadanie przyczyn hipalbuminemii obejmujących nefropatię z utratą białka, enteropatię z utratą białka, a także niewydolność wątroby (zmniejszone wydzielanie) i zmniejszone wchłanianie ze względu na nieprawidłowe wchłanianie (choroba układu pokarmowego) albo niedożywienie. Ponadto analiza ta pomaga określić stopień odwodnienia na podstawie podwyższonego stężenia albuminy w surowicy, natomiast obniżone stężenie może wskazywać na aktywny proces zapalny (ujemny wskaźnik ostrej fazy).

Tego badania nie należy wykonywać pojedynczo ze względu na brak swoistości.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Obniżone stężenie albuminy – choroba zapalna, nefropatia i enteropatia z utratą białka oraz zmniejszone wydzielanie (niewydolność wątroby).

Podwyższone stężenie albuminy – odwodnienie.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku nieodpowiedniego postępowania próbka może ulec hemolizie. Choć technologia suchych slajdów minimalizuje zakłócający wpływ hemolizy stopnia od łagodnego do umiarkowanego, wyraźna hemoliza spowoduje podwyższenie wartości oznaczenia albuminy.

Badania uzupełniające

Oznaczenie stężenia albuminy wykonuje się zazwyczaj łącznie z oznaczeniem stężenia białka całkowitego oraz innymi badaniami czynności nerek i wątroby. W przypadku łącznego pomiaru stężenia albuminy z białkiem całkowitym całkowite stężenie globulin zostanie obliczone automatycznie i uwzględnione w wynikach.

Przebieg reakcji**Fosfatazy alkalicznej (ALKP)**

Enzym fosfatazy alkalicznej jest obecny w wielu tkankach w organizmie. Najwyższe stężenia obserwuje się w korze nerek, błonie śluzowej jelita cienkiego i osteoblastach. Enzym jest również obecny w wątrobie i znajduje się głównie we włosowatych kanalikach żółciowych, zatem podwyższone stężenie ALKP może wskazywać na cholestazę.

W przypadku kotów i koni okres półtrwania wątrobowej frakcji fosfatazy alkalicznej jest bardzo krótki, a w innych naturalnych źródłach tkankowych nawet krótszy ze względu na szybkie wydalanie nerkowe/metabolizm. Czułość testu w przypadku kotów i koni jest niska. Ponieważ pozawątrobowe źródła ALKP wykazują stosunkowo krótki okres półtrwania w porównaniu do wątroby, łagodny do umiarkowanego wzrost stężenia ALKP u tych gatunków może stanowić swoisty wskaźnik cholestazy.

Główny cel wykonania badania

Wskaźnik choroby wątroby lub dróg żółciowych.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Obstrukcyjne zmiany w przewodach żółciowych. Szczególną uwagę należy poświęcić interpretacji zmian stężenia ALKP u psów ze względu na występowanie form ALKP indukowanych przez glukokortykosteroidy i inne czynniki niezwiązane z naturalnymi źródłami tkankowymi ALKP.


W przypadku psów pozawątrobowe źródła ALKP (kości, jelita, łożysko) rzadko będą wykazywać stężenia wynoszące trzykrotność górnej granicy zakresu referencyjnego ze względu na stosunkowo krótki okres półtrwania w porównaniu z indukowanymi i wątrobowymi formami ALKP. W przypadku obecności zarówno indukowanych, jak i pochodzących z wątroby form ALKP (cholestaza), aktywność enzymu w surowicy jest często wyższa od trzykrotności górnej granicy normy, zatem w przypadku stwierdzenia u psa wzrostu stężenia ALKP powyżej trzykrotności górnej granicy normy podejrzewa się cholestazę albo obecność indukowanej formy enzymu.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Nie należy używać próbek zhemolizowanych, ponieważ zanieczyszczenie ALKP pochodzącym z krwinek czerwonych spowoduje podwyższenie wyników oznaczenia, natomiast hemoglobina spowoduje ich obniżenie. Stężenia bilirubiny całkowitej wyższe od wartości prawidłowych mogą zaniżyć wyniki oznaczenia ALKP.

Badania uzupełniające

Oznaczenie aktywności fosfatazy alkalicznej wykonuje się zazwyczaj łącznie z innymi badaniami czynności wątroby i badaniami w kierunku uszkodzeń wątroby.

Przebieg reakcji**Amoniak (NH₃)**

Amoniak jest produktem katabolicznego rozkładu białek i jest niezwykle toksyczny. W wątrobie jest szybko przekształcany w mocznik, który jest wydalany z organizmu przez nerki.

Główny cel wykonania badania

Ocena czynności wątroby.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie amoniaku – obniżona objętość czynnego miąższu wątroby albo przetoka naczylniowa w wątrobie.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.

Krew należy przetworzyć i odwirować niezwłocznie po pobraniu; z tego powodu jako preferowaną próbkę zaleca się osocze.

Na oznaczenia stężenia amoniaku w osoczu albo surowicy istotny wpływ mają czynniki środowiskowe lub upływ czasu. **Bardzo ważna jest jak najmniejsza ekspozycja próbki na działanie powietrza.** Wszystkie pojemniki na próbki powinny być zamknięte, chyba że próbka jest właśnie wprowadzana albo pobierana. Nie należy podejmować próby oznaczenia stężenia amoniaku w próbkach zhemolizowanych. Zanieczyszczenie krwinkami czerwonymi spowoduje uzyskanie nieważnego wyniku.

Badania uzupełniające

Amoniak można oznaczać oddzielnie, ale częściej wykonuje się oznaczenie jednocześnie z innymi badaniami w kierunku uszkodzenia albo zaburzeń czynności wątroby, takimi jak oznaczenie przed- i poposiłkowego stężenia kwasów żółciowych.

Przebieg reakcji

NH_3 + błękit bromofenolowy (wskaźnik amoniaku) \longrightarrow niebieska barwnik

Amylaza (AMYL)

Niniejszy punkt należy czytać łącznie z punktem dotyczącym lipazy (LIPA).

Głównym źródłem amylazy w surowicy jest trzustka, chociaż istotne podwyższenie aktywności tego enzymu (powyżej zakresu referencyjnego) mogą powodować patologie wątroby i jelita cienkiego. Ponieważ amylaza jest usuwana przez nerki, patologie nerek również mogą powodować podwyższenie aktywności amylazy niezależnie od choroby trzustki.

Główny cel wykonania badania

Jako wskaźnik choroby trzustki i potencjalnego ostrego zapalenia trzustki.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Ostre martwicze zapalenie trzustki.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. Nie należy używać próbek zhemolizowanych. Nie używać szczawianu, cytrynianu ani EDTA jako antykoagulantów. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.

Próbki krwi należy pobrać w ciągu jednego dnia od wystąpienia objawów wskazujących na ostre zapalenie trzustki.

Badania uzupełniające

Amylazę i lipazę zazwyczaj oznacza się łącznie. Zasadniczo zaleca się ocenę kompleksowego profilu biochemicznego obejmującego elektrolity ze względu na wtórne następstwa ostrego zapalenia trzustki. W przypadkach podejrzenia zapalenia trzustki należy brać pod uwagę oznaczenie swoistej lipazy trzustkowej.

Przebieg reakcji

zabarwiona amylopeptyna $\xrightarrow{\text{amylaza}}$ zabarwiona sacharydy

Aminotransferazy asparaginianowej (AST)

Enzym aminotransferazy asparaginianowej jest obecny w dużych ilościach w różnych tkankach u psów, kotów i wielu innych gatunków zwierząt. Stosunkowo wysokie stężenia AST są obecne w hepatocytach, komórkach mięśnia sercowego i komórkach mięśni szkieletowych. Jest ona obecna w cytoplazmie i mitochondriach komórek oraz uwalniana do krwi w momencie uszkodzenia komórek. Jeżeli jednocześnie z podwyższeniem aktywności AST nie stwierdza się podwyższenia aktywności ALT u psów i kotów, najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie komórek mięśnia sercowego albo mięśni szkieletowych. W przypadkach podwyższonej aktywności AST w próbkach pochodzących od koni, bydła i świń należy brać pod uwagę uszkodzenie komórek wątroby, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych.

Główny cel wykonania badania

Badanie w kierunku uszkodzeń wątroby, mięśnia sercowego albo mięśni szkieletowych.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Psy i koty – w przypadku niepodwyższonej aktywności ALT: uszkodzenie mięśnia sercowego albo mięśni szkieletowych; w przypadku podwyższonej aktywności zarówno ALT, jak i AST: uszkodzenie wątroby, mięśnia sercowego albo mięśni szkieletowych.

Konie, krowy i świnie – uszkodzenie wątroby, mięśnia sercowego albo mięśni szkieletowych.

Rodzaj próbki i środki ostrożności


Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. Nie należy używać próbek zhemolizowanych, ponieważ zostaną one zanieczyszczone AST pochodzącym z krwinek czerwonych. Nie należy używać EDTA ani fluorku/szczawianu jako antykoagulantów. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.

Próbki krwi należy przetworzyć i odwirować niezwłocznie po pobraniu. Nawet nieznaczna hemoliza może spowodować wyraźny wzrost aktywności ze względu na wysokie stężenia wewnątrzkomórkowe AST w krwinkach czerwonych.

Badania uzupełniające

Oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej wykonuje się zazwyczaj łącznie z innymi badaniami czynności wątroby, mięśnia sercowego albo mięśni szkieletowych albo badaniami w kierunku ich uszkodzeń.

Przebieg reakcji



Kwasy żółciowe (BA)

Kwasy żółciowe są wytwarzane w wątrobie, przechowywane w pęcherzyku żółciowym i uwalniane do jelita, gdzie wspomagają trawienie lipidów. U zdrowych zwierząt kwasy żółciowe ulegają wydajnej reabsorpcji z jelita i są ponownie kierowane do wątroby przez żyłę wrotną. Po dotarciu do wątroby kwasy żółciowe są usuwane z krążenia przez hepatocyty. W stanach chorobowych albo w przypadku nieprawidłowego przepływu krwi w układzie wrotnym może dojść do wzrostu stężenia kwasów żółciowych w krążeniu dużym, co wskazuje na obniżenie czynności wątroby.

Główny cel wykonania badania

Badanie stężenia kwasów żółciowych służy głównie ocenie pod kątem utraty czynności wątroby albo występowania przetok systemowo-wrotnych, jednak wyniki badań stężenia kwasów żółciowych mogą być podwyższone również w chorobach cholestatycznych, które powodują zatrzymanie żółci. Badanie stężenia kwasów żółciowych jest szczególnie użyteczne w przypadku podejrzenia choroby wątroby przed przeprowadzeniem badań bardziej kosztownych albo inwazyjnych (np. badania ultrasonograficznego, biopsji). Badanie stężenia kwasów żółciowych może być przydatne również do monitorowania wpływu określonych leków na czynność wątroby oraz w ramach oceny w kierunku encefalopatii wątrobowej u pacjentów z objawami neurologicznymi. Dodatkowe informacje można znaleźć w Algorytmie kwasów żółciowych IDEXX.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone przed- i poposiłkowe stężenia kwasów żółciowych wskazują na zaburzenia czynności wątroby. Prawidłowe stężenie kwasów żółciowych nie wyklucza obecności choroby wątroby. Łagodne podwyższenie stężenia może występować również w przypadku chorób pozawątrobowych (np. zespół jelitowego przerostu bakteryjnego [ZJPB], nadczynność kory nadnerczy itp.). Podwyższenie stężenia w stopniu umiarkowanym do ciężkiego wskazuje na zaburzenia czynności wątroby, ale nie pozwala rozróżnić konkretnych chorób wątroby ani względnego nasilenia choroby wątroby, ani też jej odwracalności. Dodatkowe informacje można znaleźć w rozpoznaniach różnicowych dotyczących kwasów żółciowych w interfejsie VetConnect* PLUS.

Rodzaje próbek i środki ostrożności

Do testu Catalyst Bile Acids można używać surowicy, osocza pobranego na heparynę litową i krwi pełnej (przy użyciu separatora krwi pełnej Catalyst Lithium Heparin Whole Blood Separator). Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. IDEXX nie zaleca zamrażania próbek, które będą analizowane przy użyciu testu Catalyst Bile Acids.

- Test Catalyst Bile Acids jest odporny na lipemię.
- Umiarkowana lub wyraźna hemoliza może spowodować zawyżenie wyników testu Catalyst Bile Acids.
- Jeśli stężenie bilirubiny w surowicy/osoczu jest podwyższone lub zwierzę ma objawy żółtaczki, badania kwasów żółciowych mają niewielką dodatkową wartość diagnostyczną. Próbki żółtaczkowe mogą powodować umiarkowane zawyżenie wyników testu Catalyst Bile Acids.
- Należy uważać, aby podczas przygotowania surowicy/osocza nie doszło do aspiracji krwinek, i upewnić się, że separator krwi pełnej Catalyst Lithium Heparin Whole Blood Separator napełniono do objętości 700–800 µl, aby zapobiec przepełnieniu.

W celu zwiększenia czułości zaleca się przeprowadzenie testu stymulacji, który obejmuje pobranie próbek przed- i poposiłkowych przy zastosowaniu typowych protokołów stymulacji kwasów żółciowych. Zaleca się następujący protokół stymulacji kwasów żółciowych:


1. Pozostaw kota albo psa na czczo przez około 12 godzin i pobierz próbkę na czczo (próbki przedposiłkową). Uzyskaj przedposiłkowy wynik testu Catalyst Bile Acids.
2. Podaj zwierzęciu niewielką ilość wysokotłuszczowego pokarmu w celu pobudzenia skurczów pęcherzyka żółciowego.
 - Zalecana minimalna ilość pokarmu w przypadku małych pacjentów (<4,5 kg) wynosi dwie łyżeczki do herbaty, a w przypadku dużych pacjentów – dwie łyżki stołowe.
 - Jeżeli spodziewane jest wystąpienie objawów encefalopatycznych po spożyciu białka, należy zastosować pokarm niskobiałkowy zmieszany z niewielką ilością oleju kukurydzianego.
3. Dwie godziny po karmieniu pobierz próbkę poposiłkową. Uzyskaj poposiłkowy wynik testu Catalyst Bile Acids.

Badania uzupełniające

Badanie stężenia kwasów żółciowych wykonuje się najczęściej, gdy nieprawidłowe wyniki podstawowych badań diagnostycznych nasuwają podejrzenie zaburzeń czynności wątroby. Do badań, których nieprawidłowe wyniki w połączeniu z odpowiednimi objawami klinicznymi mogą sugerować potrzebę przeprowadzenia badania stężenia kwasów żółciowych, należą:

- badanie morfologiczne krwi (obniżona wartość MCV);
- badania biochemiczne (obniżone stężenia albumin, BUN, glukozy albo cholesterolu; podwyższona aktywność ALT, AST, ALKP, GGT albo stężenie amoniaku);
- badanie ogólne moczu (obecność kryształów dwumoczanu amonu w moczu).

W przypadku podwyższonego stężenia bilirubiny albo występowania żółtaczki u zwierzęcia badanie stężenia kwasów żółciowych ma niewielką wartość dodatkową.

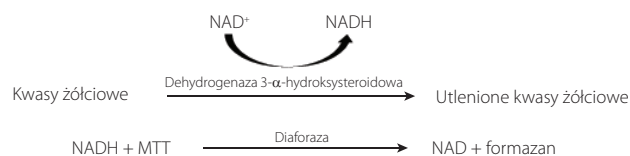Przebieg reakcji**Azot mocznikowy we krwi (BUN)**

W wyniku katabolizmu białek wytwarzany jest amoniak, który jest niezwykle toksyczny. Amoniak jest przekształcany w mocznik w wątrobie i wydalany z organizmu w drodze przesączania kłębuszkowego w nerkach.

Główny cel wykonania badania

Jako wskaźnik choroby nerek albo stanów patologicznych skutkujących krwawieniem do przewodu pokarmowego.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie mocznika – azotemia przednerkowa, pozanerkowa i nerkowa przy obniżonym współczynniku przesączania kłębuszkowego; dieta wysokobiałkowa albo krwawienie do przewodu pokarmowego.

Obniżone stężenie mocznika – obniżona podaż białka; niewydolność wątroby; diureza.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.

Nie należy pobierać krwi do oznaczenia stężenia mocznika w ciągu sześciu godzin po posiłku. Nie używać fluorku sodu ani EDTA jako antykoagulantu. W próbkach zawierających hemoglobinę stężenie azotu mocznikowego jest zawyżone.

Badania uzupełniające

Oznaczenie stężenia mocznika należy zasadniczo wykonywać łącznie z oznaczeniami stężeń kreatyniny, fosforanów nieorganicznych, białka całkowitego i albumin oraz pełnym badaniem ogólnym moczu. Dieta wysokobiałkowa wywiera większy wpływ na stężenie mocznika niż stężenie kreatyniny.

Przebieg reakcji**Wapń (Ca)**

Wapń jest pierwiastkiem niezbędnym, który pełni funkcje w wielu układach narządów. Obejmują one układ kostny, aktywację enzymów, metabolizm mięśni, krzepnięcie krwi i osmoregulację. We krwi wapń występuje w postaci zjonizowanej i związanej z białkami. Czynniki regulujące jego całkowite stężenie w osoczu, krwi pełnej albo surowicy są złożone i obejmują oddziaływania z innymi ugrupowaniami chemicznymi, białkami i hormonami.

Metabolizm wapnia, fosforu i albuminy wykazuje współzależność.

Główny cel wykonania badania

Jako wskaźnik występowania określonych nowotworów, chorób kości, chorób przytarczyc, zrzucawki i choroby nerek.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie wapnia – hiperkalcemia nowotworowa (wywołana wydzielaniem przez guz substancji podobnych do PTH), hiperkalcemia rzekoma.

Obniżone stężenie wapnia – potencjalna niewydolność nerek skutkująca hiperfosfatemią, hipokalcemia rzekoma.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.


Próbkę należy odwirować wkrótce po pobraniu. Nie należy wystawiać próbki na działanie powietrza przez dłuższy czas. Należy starannie myć szkło w celu uniknięcia zanieczyszczenia źródłami wapnia (np. detergentami). Długi kontakt ze skrzepem może powodować zniżenie stężeń wapnia ze względu na rozcieńczenie wodą pochodzącą z krwinek czerwonych.

Nie używać probówek zawierających fluorek, szczawian, cytrynian ani EDTA, ponieważ związki te powodują istotne fałszywe zniżenie wyników z powodu chelatacji wapnia.

Jeżeli nie można przeprowadzić analizy w ciągu czterech godzin, należy oddzielić próbkę od krwinek czerwonych i przechowywać krótkoterminowo (przez maksymalnie 24 godziny) w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce w temperaturze 2°C–8°C. Nie należy zamrażać próbki. Przed wykonaniem analizy należy odczekać, aż próbka osiągnie temperaturę pokojową.

Badania uzupełniające

Oznaczenie stężenia wapnia należy wykonywać łącznie z oznaczeniami stężeń fosforanów nieorganicznych, albumin, białka całkowitego i glukozy. Oznaczenie stężenia wapnia zjonizowanego dostarczy bardziej swoistych informacji dotyczących postaci fizjologicznej wapnia.

Przebieg reakcji**Chlorki (Cl)**

Anion chlorkowy to główny anion obecny przeważnie w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, gdzie poprzez wywieranie wpływu na ciśnienie osmotyczne utrzymuje integralność komórek. Oznaczenie stężenia chlorków jest istotne dla monitorowania równowagi kwasowo-zasadowej i równowagi wodno-elektrolitowej.

Główny cel wykonania badania

Niskie stężenie chlorków występuje zazwyczaj w przypadku ciężkich wymiotów albo biegunki, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ciężkich oparzeń, wyczerpania z gorąca, gorączki i ostrych zakażeń. Podwyższone stężenie występuje w przypadku odwodnienia, hiperwentylacji, niedokrwistości i dekompensacji serca.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Hiperchloremia – w przypadku jednoczesnego podwyższenia stężenia sodu ta sama przyczyna, co w hipernatemii. Bez jednoczesnego podwyższenia stężenia sodu: kwasica hiperchloremiczna: utrata HCO₃ przez przewód pokarmowy albo nerki.

Hipochloremia (bez towarzyszącej zmiany stężenia sodu) – utrata przez górny odcinek przewodu pokarmowego (wymioty).

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Należy unikać hemolizy – próbkę należy analizować jak najszybciej po oddzieleniu surowicy albo osocza od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Obecność bromku potasu może powodować zawyżenie wyników oznaczenia elektrolitów przy użyciu analizatora Catalyst.

Nie należy zamrażać próbek przeznaczonych do badania przy użyciu analizatora Catalyst One.

Badania uzupełniające

Należy zawsze oznaczać sód, potas i chlorki łącznie w celu określenia równowagi elektrolitowej. W przypadku jednoczesnego oznaczenia stężeń sodu, potasu, chlorków i wodorowęglanów możliwa jest dokładna ocena stanu metabolicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i stanu fizjologicznego.

Przebieg reakcji

Chlorek + barwnik fluorescencyjny \longrightarrow zmiana fluorescencji

Cholesterol (CHOL)

Cholesterol jest obecny w surowicy w wysokim stężeniu głównie w postaci zestryfikowanej, a jego pozostała część znajduje się w postaci wolnej. Cholesterol jest syntetyzowany w wątrobie i innych tkankach, a także jest wchłaniany w postaci wolnej z jelita cienkiego. Ulega on estryfikacji w wątrobie i jest prekursorem hormonów steroidowych.

Cholesterol jest rozkładany w wątrobie do kwasów żółciowych i jest wydalany przez przewody żółciowe.

Główny cel wykonania badania

Może stanowić marker zastoju żółci albo chorób układu wewnątrzwydzielniczego, takich jak niedoczynność tarczycy, nadczynność kory nadnerczy bądź cukrzyca, jak również zespołu nerczykowego.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie cholesterolu – niedoczynność tarczycy, poposiłkowo, zespół nerczykowy.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. Nie należy pobierać krwi w ciągu 12 godzin po posiłku. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.

Badania uzupełniające

Oznaczeń stężenia cholesterolu nie należy wykonywać osobno, ale w ramach panelu badań pod kątem chorób układu wewnątrzwydzielniczego, wątroby i nerek. W przypadku stwierdzenia wysokiego stężenia cholesterolu przy braku cukrzycy, chorób wątroby albo nerek może występować niedoczynność tarczycy. Można ją ocenić, oznaczając czynność tarczycy.

Przebieg reakcji

lipoproteina $\xrightarrow[\text{TX100}]{\text{surfaktant}}$ cholesterol + estry cholesterolu + białka

estry cholesterolu + H₂O $\xrightarrow{\text{hydrolaza estrów cholesterolu}}$ cholesterol + kwasy tłuszczowe

cholesterol + O₂ $\xrightarrow{\text{oksydaza cholesterolowa}}$ cholest-4-en-3-one + H₂O₂

H₂O₂ + leukobarwnik $\xrightarrow{\text{peroksydaza}}$ barwnik + 2H₂O

Kinaza kreatynowa (CK)

Wysoka aktywność kinazy kreatynowej występuje wyłącznie w cytoplazmie komórek mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych. Enzym ten katalizuje odwracalną fosforylację kreatyny z wykorzystaniem ATP i z wytworzeniem fosforanu kreatyny i ADP. Fosforan kreatyny jest głównym źródłem fosforanu wysokoenergetycznego zużywanego podczas skurczu mięśni.

Główny cel wykonania badania

Wykrywanie uszkodzeń mięśni szkieletowych albo mięśnia sercowego.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu


Uszkodzenia mięśni szkieletowych związane z urazami albo intensywnym wysiłkiem.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Próbki należy przetworzyć i odwirować niezwłocznie po pobraniu krwi. Próbki krwi należy pobrać w ciągu sześciu godzin od powstania podejrzanego uszkodzenia. Ważne jest ustalenie, że pacjent nie wykonywał intensywnego wysiłku w ciągu 12 godzin poprzedzających pobranie próbki. Może to spowodować wyraźny wzrost aktywności kinazy kreatynowej. Osocze albo surowicę należy oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. EDTA i fluorek/szczawian spowodują zaniżenie wyniku oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej.

Badania uzupełniające

Oznaczenie aktywności kinazy kreatynowej dostarcza swoistych i czułych dowodów na uszkodzenie komórek mięśniowych. Można oznaczyć również aktywność aminotransferazy asparaginianowej i dehydrogenazy mleczanowej, ale jest ona mniej swoista i wykazuje mniejszy wzrost w przypadku uszkodzenia mięśni.

Przebieg reakcji**Kreatynina (CREA)**

Kreatynina jest produktem rozpadu kreatyny powstającym w toku metabolizmu mięśni. Wytwarzanie kreatyniny w ciągu doby jest dość stałe, a wiek, dieta, wysiłek ani katabolizm nie wywierają wyraźnego wpływu na nie. Kreatynina jest wydalana z organizmu na drodze przesączania kłębuszkowego i sekrecji kanalikowej w nerkach.

Główne powody wykonania badania

Jako wskaźnik choroby nerek lub parametr związany ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie kreatyniny – azotemia przednerkowa, pozanerkowa i nerkowa.

Rodzaj próbki i środki ostrożności


Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.

Obecność w próbce substancji zakłócających, takich jak kreatyna, może mieć niekorzystny wpływ na możliwość podania przez analizator dokładnych wyników oznaczenia kreatyniny. Jeżeli analizator wykrywa taką substancję zakłócającą, do uzyskania dokładnego stężenia kreatyniny może być wymagane rozcieńczenie próbki.

Badania uzupełniające

Dla właściwej interpretacji wzrostu stężenia kreatyniny kluczowe jest pełne badanie ogólne moczu z pomiarem ciężaru właściwego metodą refraktometryczną. Oznaczenie stężenia kreatyniny należy zazwyczaj wykonywać łącznie z oznaczeniami stężeń azotu mocznikowego we krwi, fosforanów nieorganicznych, białka całkowitego i albumin. Badanie morfologiczne krwi może niekiedy wykazać zmiany takie jak niedokrwistość nieregeneratywna występująca w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.

Przebieg reakcji



Białko C-reaktywne (CRP)

Białko C-reaktywne (CRP) jest głównym białkiem ostrej fazy wydzielanym przez wątrobę w odpowiedzi na ogólnoustrojowy stan zapalny u niektórych gatunków, w tym u psów. Test Catalyst CRP Test to kanapkowy test immunologiczny z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych skoniugowanych z nanocząsteczkami złota i cząsteczkami lateksu służący do oznaczenia stężenia CRP.

Główny cel wykonania badania

CRP jest bardzo czułym biomarkerem czynnego ogólnoustrojowego stanu zapalnego u psów. CRP umożliwia lekarzowi weterynarii wczesne wykrycie czynnego stanu zapalnego, scharakteryzowanie nasilenia odpowiedzi zapalnej oraz ściśle monitorowanie ustępowania albo postępu procesu zapalnego po zastosowaniu interwencji leczniczej.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Stężenie CRP będzie istotnie podwyższone we wszelkich schorzeniach, w których występuje czynny ogólnoustrojowy stan zapalny. Wzrost stężenia CRP jest skorelowany z nasileniem stanu zapalnego. Podwyższone stężenie CRP może występować w przypadku zakaźnych i niezakaźnych chorób zapalnych (tj. zapalenia płuc, zapalenia trzustki, odmiedniczkowego zapalenia nerek, ropomacicza, posocznicy i ropniaka opłucnej), chorób o podłożu immunologicznym (tj. anemii hemolitycznej i zapalenia wielostawowego o podłożu immunologicznym), jak również stanu zapalnego związanego z uszkodzeniem tkanek występującego po poważnych zabiegach chirurgicznych.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Próbki, które można wykorzystać do oznaczenia stężenia CRP, to surowica, osocze i krew pełna (przy użyciu separatora krwi pełnej Catalyst* Lithium Heparin Whole Blood Separator). Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.

W razie badania stężenia CRP u pacjentów z podejrzeniem ciężkiego ogólnoustrojowego stanu zapalnego można rozcieńczyć próbkę, aby uniknąć powtórnego badania w przypadku uzyskania stężeń CRP powyżej 10,0 mg/dl (100,0 mg/l). Zaleca się rozcieńczanie w stosunku: jedna część surowicy albo osocza na jedną część fizjologicznego roztworu soli (0,9% roztwór soli). IDEXX zaleca rozcieńczanie wyłącznie próbek, w przypadku których uzyskano wyniki poza zakresem pomiaru. Rozcieńczanie próbek, w przypadku których uzyskano wyniki mieszczące się w zakresie wartości prawidłowych, może skutkować uzyskaniem nieważnych wyników;

Uwaga: nie należy rozcieńczać próbek krwi pełnej przetwarzanych przy użyciu separatora krwi pełnej.

Nie można przeprowadzić badania CRP w jednym cyklu z testem w kierunku fenobarbitalu (PHBR).

Badania uzupełniające

Ocenę stężenia CRP należy przeprowadzać łącznie z dokładnym wywiadem medycznym, badaniem przedmiotowym, badaniem morfologicznym krwi, pełnym profilem biochemicznym i badaniem ogólnym moczu, aby uzyskać kompleksowe wyniki w przypadku podejrzenia ogólnoustrojowego stanu zapalnego. W razie podejrzenia zakażenia do dokonania ostatecznego rozpoznania konieczne jest wykrycie patogenu.

Fruktozamina (FRU)

Fruktozamina to glikowane albuminy albo inne białka. Jej stężenie jest zależne od stężenia glukozy we krwi w ciągu poprzednich 2–3 tygodni.

Główny cel wykonania badania

Oznaczenie stężenia fruktozaminy w ramach rutynowej oceny pacjenta z cukrzycą poddawanego leczeniu. Dostarcza informacji dotyczących stanu kontroli glikemii w ciągu 2–3 tygodni poprzedzających ocenę. U kotów można oznaczać stężenie fruktozaminy w celu stwierdzenia, czy przyczyną wysokiego stężenia glukozy we krwi jest odpowiedź na stres, czy też cukrzyca. Ponadto w trakcie leczenia cukrzycy zarówno u psów, jak i u kotów, wykorzystuje się stężenie fruktozaminy do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy wywiadem i wynikami badania przedmiotowego oraz wynikami oznaczeń stężenia glukozy we krwi, a także do oceny skuteczności leczenia.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie fruktozaminy wskazuje na brak regulacji stężenia glukozy albo jego niedostateczną regulację w związku z cukrzycą. Stężenie fruktozaminy jest podwyższone w przypadku niedostatecznej kontroli glikemii i spada po osiągnięciu poprawy kontroli glikemii. Rzadziej występujące niskie stężenie fruktozaminy może wskazywać na długotrwałą hipoglikemię.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Próbki, które można wykorzystać do oznaczenia stężenia FRU, to surowica, osocze i krew pełna (przy użyciu separatora krwi pełnej Catalyst* Lithium Heparin Whole Blood Separator). Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Jeżeli nie można przeprowadzić analizy FRU w ciągu czterech godzin od pobrania próbki, przetworzoną surowicę można przechowywać w zamrażarce (w temperaturze -18°C) przez maksymalnie miesiąc.

Ważne jest, aby jak najszybciej oddzielić próbkę od krwinek czerwonych.

Do celów badania stężenia fruktozaminy preferowana jest surowica, ponieważ z doświadczeń klientów wynika, że umożliwia ona bardziej spójne uzyskiwanie próbek dobrej jakości.

Należy ocenić surowicę albo osocze pod kątem hemolizy. Chociaż technologia suchych slajdów IDEXX znacząco ogranicza wpływ tej substancji interferującej, to znaczna hemoliza może powodować niedokładne wyniki oznaczenia fruktozaminy. Znaczna hemoliza powoduje zazwyczaj zaniżenie wartości uzyskanej przy użyciu analizatorów Catalyst.

Przebieg reakcji

Fruktozamina + NBT $\xrightarrow{\text{OH}}$ barwnik formazanowy (przy długości fali 560 nm)

Gamma-glutamylotransferazy (GGT)

Enzym gamma-glutamylotransferazy jest związany z błoną. Jest on obecny w dużej ilości w rdzeniu i korze nerki, a także w mniejszym stopniu w błonie śluzowej jelita cienkiego i nabłonku przewodów żółciowych.

Pomimo wysokiej aktywności gamma-glutamylotransferazy w nerkach choroba nerek nie powoduje wysokiej aktywności tego enzymu w próbkach surowicy. GGT w nerkach jest związana głównie z komórkami nabłonka wyściełającymi kanaliki nerkowe, a enzym jest zlokalizowany w apikalnej części komórki. Zmiany patologiczne w komórkach nabłonka kanalików powodują utratę GGT bezpośrednio do moczu. Oznaczenie aktywności GGT w moczu może stanowić czuły wskaźnik uszkodzenia komórek nabłonka kanalików/nefrotoksyczności.

Główny cel wykonania badania

Jako wskaźnik zastój żółci albo choroby pęcherzyka żółciowego.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższona aktywność GGT – zastój żółci.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Nie należy używać próbek zhemolizowanych. Nie używać fluorku/szczawianu jako antykoagulantu.

Badania uzupełniające

Oznaczenie aktywności gamma-glutamylotransferazy w surowicy wykonuje się zazwyczaj łącznie z innymi badaniami czynności wątroby albo badaniami w kierunku uszkodzeń wątroby.

Przebieg reakcji**Glukoza (GLU)**

Glukoza jest głównym źródłem energii u ssaków monogastrycznych. U zdrowego zwierzęcia jej stężenie w krwiobiegu jest utrzymywane w wąskim zakresie.

Główny cel wykonania badania

Badanie metabolizmu węglowodanów.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie glukozy – cukrzyca; wpływ glikokortykosteroidów; wpływ adrenaliny.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Na potrzeby oznaczeń stężenia glukozy zwierzę powinno pozostawać na czczo przez 5–8 godzin przed pobraniem próbki. Na wynik oznaczenia glukozy może wpływać hemoliza.

Dotyczy próbek osocza: Należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. W przypadku pobierania krwi na heparynę litową ważne jest, aby odwirować próbkę niezwłocznie po pobraniu. W przypadku stosowania tego antykoagulantu w obecności krwinek czerwonych dość szybko zachodzi glikoliza, a stężenie glukozy w próbce może spadać nawet o 10% na godzinę w temperaturze pokojowej. Należy niezwłocznie oddzielić osocze od krwinek czerwonych. Nie należy używać próbek zhemolizowanych.

Dotyczy próbek surowicy: Nie należy odwirowywać próbek surowicy, dopóki nie ulegną całkowitemu skrzepnięciu. Należy całkowicie odwirować próbki. Należy niezwłocznie oddzielić surowicę od skrzepu, aby uniknąć metabolizowania glukozy przez komórki. Zaleca się, aby czas pomiędzy pobraniem a oddzieleniem od skrzepu wynosił maksymalnie 30 minut. Nie należy używać próbek zhemolizowanych.

Badania uzupełniające

W przypadku rozpoznania u pacjenta cukrzycy można wykonywać badania stężenia glukozy oddzielnie. Jednak przydatne jest wykonywanie innych badań oceniających czynność nerek i wątroby oraz metabolizm lipidów w celu monitorowania wtórnych następstw niedostatecznie kontrolowanej cukrzycy. Ze względu na to, że u zwierząt domowych, w szczególności u kotów, stres może powodować istotny wzrost stężenia glukozy powyżej zakresu referencyjnego, w przypadkach podejrzenia cukrzycy należy wziąć pod uwagę oznaczenie stężenia fruktozaminy. Należy także przeprowadzić równocześnie badanie ogólne moczu w celu oceny obecności glukozy i ketonów.

Przebieg reakcji**Fosforany nieorganiczne (PHOS)**

Fosfor pełni istotną rolę jako produkt przejściowy metabolizmu, a także stanowi składnik kwasów nukleinowych, fosfolipidów i nukleotydów. Fosforany są również ważnymi składnikami układów buforowych w płynach ustrojowych. Fosforany i wapń są wchłaniane w jelicie cienkim. Na ich wchłanianie ma wpływ obecność innych składników mineralnych, składników odżywczych i witamin oraz wartość pH w jelicie. Metabolizm wapnia i fosforu jest współzależny.

Główny cel wykonania badania

Jako parametr związany ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu



Podwyższone stężenie fosforanów nieorganicznych – zmniejszone przesączanie kłębuszkowe.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Nie używać szczawianu, fluorku, cytrynianu ani EDTA jako antykoagulantów. Próbkę krwi należy przetworzyć i odwirować jak najszybciej po pobraniu, ponieważ fosforany są szybko uwalniane z krwinek czerwonych. Hemoliza może spowodować znaczny wzrost stężenia fosforanów.

Badania uzupełniające

Oznaczenie stężenia fosforanów nieorganicznych należy wykonywać łącznie z oznaczeniami stężeń wapnia, albumin, białka całkowitego i glukozy. W razie podejrzenia choroby nerek należy również oznaczyć stężenia azotu mocznikowego we krwi, kreatyniny, albumin, i białka całkowitego oraz przeprowadzić badanie ogólne moczu.

Przebieg reakcji**Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)**

Enzym dehydrogenaza mleczanowa występuje w dużych ilościach we wszystkich narządach i tkankach (w tym we krwinkach czerwonych) wszystkich zwierząt. Jest on obecny w cytoplazmie komórek i jest uwalniany do krwi w momencie powstania odwracalnych i nieodwracalnych (martwica) uszkodzeń komórek. To badanie nie stanowi swoistego ani czułego wskaźnika uszkodzeń żadnych narządów ani tkanek.

Uwaga: Zakres wartości prawidłowych aktywności dehydrogenazy mleczanowej u psów i kotów jest szeroki, ponieważ u tego samego zwierzęcia aktywność może różnić się w poszczególnych dniach. W związku z tym trudno wykryć niewielki wzrost aktywności spowodowany nieznacznym uszkodzeniem narządów. Oznaczenie dehydrogenazy mleczanowej jest dość tradycyjnym badaniem, a jego wartość diagnostyczna w praktyce jest ograniczona.

Główny cel wykonania badania

Badanie w kierunku uszkodzeń wątroby, mięśnia sercowego albo mięśni szkieletowych.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższenie aktywności jest zazwyczaj związane z uszkodzeniami miększu wątroby.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu i jak najszybciej poddać analizie. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Nie należy używać fluorku/szczawianu ani EDTA jako antykoagulantów.

Nie należy używać próbek zhemolizowanych, ponieważ zostaną one zanieczyszczone LDH pochodzącym z krwinek czerwonych.

Badania uzupełniające

Oznaczenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej wykonuje się zazwyczaj łącznie z innymi badaniami czynności wątroby, mięśnia sercowego albo mięśni szkieletowych albo badaniami w kierunku ich uszkodzeń.

Przebieg reakcji**Mleczan (LAC)**

Mleczan jest wytwarzany w drodze metabolizmu beztlenowego glukozy, a jego stężenie jest zależne od różnicy pomiędzy szybkością jego wytwarzania w komórkach mięśniowych i erytrocytach a szybkością metabolizmu w wątrobie.

Główny cel wykonania badania

Podwyższenie stężenia mleczanu jest zazwyczaj powodowane przez nadmierne wytwarzanie albo niedostatecznie wydajny metabolizm. Jest to skutkiem hipoksji tkankowej, cukrzycy, nowotworów złośliwych, spożycia etanolu albo metanolu i kwasicy metabolicznej.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Hipoksja w (druga) wobec bardzo intensywnego wysiłku, wstrząs, hipowolemia, choroba serca, obrzęk płuc i napady drgawkowe.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Należy używać próbek pobranych na heparynę litową albo fluorek/szczawian. W przypadku używania próbek pobranych na heparynę litową należy oddzielić osocze od krwinek czerwonych w ciągu pięciu minut po pobraniu próbki.

Badania uzupełniające

Badanie morfologiczne krwi, panel biochemiczny, pełne badanie ogólne moczu i gazometria.

Przebieg reakcji

Lipaza (LIPA)

Lipaza jest wydzielana przez trzustkę i w mniejszym stopniu przez błony śluzowe przewodu pokarmowego. Lipaza jest stosunkowo czułym wskaźnikiem patologii trzustki (w porównaniu z amylazą). Zasadniczo wartość wyższa niż trzykrotność górnej granicy zakresu referencyjnego wskazuje na zapalenie trzustki.

Główny cel wykonania badania

Jako wskaźnik ostrego zapalenia trzustki.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Ostre zapalenie trzustki.



Rodzaj próbki i środki ostrożności

Próbki krwi należy pobrać w ciągu jednego dnia od wystąpienia objawów wskazujących na ostre zapalenie trzustki. Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Nie używać szczawianu/fluorku, cytrynianu ani EDTA jako antykoagulantów. Lipemia i żółtaczka mogą powodować zawyżenie wyników oznaczenia lipazy.

Badania uzupełniające

Oznaczenie aktywności lipazy i amylazy wykonuje się zazwyczaj łącznie z badaniami czynności wątroby i trzustki albo badaniami w kierunku ich uszkodzeń. W przypadkach wątpliwych należy wykonać badania aktywności psiej i kocięj swoistej lipazy trzustkowej.

Przebieg reakcji



Magnez (Mg)

Magnez pełni ważną rolę we wnętrzu komórki w aktywacji enzymów, w tym enzymów odpowiedzialnych za wiele procesów anabolicznych i katabolicznych. Bierze również udział w wytwarzaniu i rozkładzie acetylocholin, która odpowiada za przekaz sygnałów elektrycznych przez płytkę nerwowo-mięśniową. Stężenie magnezu w surowicy jest regulowane przez nadnercza, tarczycę i przytarczycę.

Główny cel wykonania badania

Nie zbadano w pełni istotności oznaczenia stężenia magnezu w surowicy u psów i kotów. Zgłaszano jednak występowanie hipomagnezemu u psów po usunięciu przytarczyc.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie magnezu – zmniejszone przesączanie kłębuszkowe.

Obniżone stężenie magnezu – usunięcie przytarczyc.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Próbki krwi należy odwirować niezwłocznie po pobraniu, ponieważ magnez jest uwalniany z erytrocytów ulegających hemolizie i może powodować fałszywe zawyżenie wyników oznaczenia stężenia magnezu. Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Nie używać szczawianu/cytrynianu ani EDTA jako antykoagulantów. Użycie probówek do pobierania krwi zawierających fluorki sodu jako środek konserwujący powoduje zaniżenie wyników.

Przebieg reakcji**Fenobarbital (PHBR)**

Fenobarbital to lek powszechnie stosowany w leczeniu napadów drgawkowych u różnych gatunków. Należy oceniać stężenia fenobarbitalu po podaniu pierwszych dawek i przez cały czas trwania leczenia w celu upewnienia się, że jego stężenia we krwi mieszczą się w docelowym zakresie leczniczym.

Główne powody wykonania badania

Fenobarbital to lek ograniczonej dostępności, należący do grupy barbituranów, stosowany w leczeniu pacjentów weterynaryjnych, u których występują napady drgawkowe. Aby fenobarbital wykazywał skuteczność, jego dawkowanie należy utrzymywać w określonym zakresie. Jeżeli stężenie fenobarbitalu wynosi $<10 \mu\text{g/ml}$, może ono być niewystarczające do zapobiegania napadom drgawkowym. Jeżeli stężenie wynosi $>30 \mu\text{g/ml}$ u kotów albo $>40 \mu\text{g/ml}$ u psów, fenobarbital może wykazywać działanie toksyczne i potencjalnie zagrażające życiu.

U większości pacjentów stan stabilny osiąga się po upływie 2–3 tygodni ciągłego podawania fenobarbitalu. Po osiągnięciu stanu stabilnego u ponad 90% pacjentów czas pobrania próbki jest nieistotny. Jednakże okres półtrwania fenobarbitalu u niewielkiej liczby procentowej pacjentów może się różnić. W związku z tym w razie podejrzenia toksyczności przydatna może być próbka pobrana po osiągnięciu stężenia szczytowego (po upływie 4–5 godzin od podania tabletki), a w razie nawrotu napadów drgawkowych i podejrzenia nieodpowiedniego dawkowania przydatny może być pomiar stężenia minimalnego (pobranie bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki).

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu


Przedawkowanie albo niedostateczne dawkowanie leku.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Nie należy używać probówek z aktywatorem wykrzepiania, ponieważ kontakt z żelem może spowodować obniżenie stężenia.

Badania uzupełniające

Badanie morfologiczne krwi, pełny panel biochemiczny, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kwasów żółciowych (co najmniej dwa razy w roku)

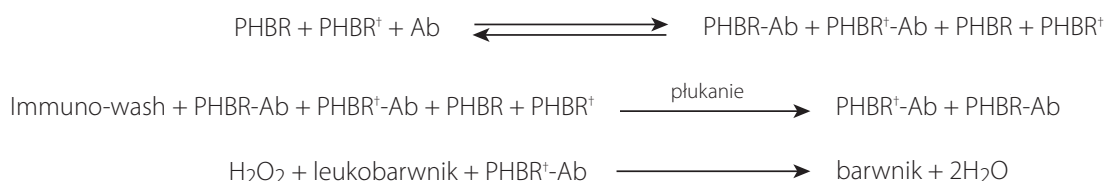Przebieg reakcji

[†]PHBR = koniugat fenobarbital-peroksydaza

Potas (K)

Potas jest głównym kationem w płynie wewnątrzkomórkowym, gdzie działa jako główny bufor w komórce, umożliwia przewodnictwo nerwowe i działanie mięśni oraz pomaga utrzymać ciśnienie osmotyczne. Nieprawidłowo wysokie albo niskie stężenie potasu może powodować zmiany w drażliwości mięśni, oddychaniu i czynności serca.

Główne powody wykonania badania

Wysokie stężenie potasu (hiperkaliemia) występuje zazwyczaj w przypadku zastoju moczu, niewydolności nerek, kwasicy metabolicznej albo oddechowej oraz niedoczynności kory nadnerczy, jak również w przypadku nadmiernej hemolizy u koni, bydła, kotów i niektórych ras psów. Obniżone stężenia (hipokaliemia) występują zazwyczaj w wyniku nadmiernej utraty soli spowodowanej ciężkimi wymiotami albo biegunką, niedostatecznej podaży, jadłowstrętu (szczególnie u kotów), nieprawidłowego wchłaniania i ciężkich oparzeń.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Hiperkaliemia – niewydolność nerek, niedrożność dróg moczowych.

Hipokaliemia – nadmierna utrata potasu.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Należy unikać hemolizy. Obecność bromku potasu może powodować zawyżenie wyników oznaczenia elektrolitów przy użyciu analizatora Catalyst.

Nie należy zamrażać próbek przeznaczonych do badania przy użyciu analizatora Catalyst One.

Badania uzupełniające

Należy zawsze oznaczać sód, potas i chlorki łącznie w celu określenia równowagi elektrolitowej. Dodatkowe oznaczenie stężenia wodorowęglanów umożliwia dokładną ocenę stanu metabolicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i stanu fizjologicznego.

Test stymulacji ACTH w przypadkach podejrzenia niedoczynności kory nadnerczy.

Przebieg reakcji

Potas + barwnik fluorescencyjny jonoforowy \longrightarrow zmiana fluorescencji

Progesteron

Progesteron jest żeńskim hormonem reprodukcyjnym. U suk następuje zwiększenie jego wytwarzania od późnej fazy przedrujowej, podczas rui, aż do fazy międzyrujowej. U większości gatunków jest on niezbędny do podtrzymania ciąży.

Główny cel wykonania badania

Badanie stężenia progesteronu u suk służy między innymi do:

- przewidywania (a następnie potwierdzenia) owulacji w celu określenia czasu krycia;
- przewidywania daty porodu lub czasu wykonania cięcia cesarskiego;
- badania nieprawidłowości rozrodczych.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Test Catalyst Progesterone zoptymalizowano do użytku z krwią pełną psów (przy użyciu separatora krwi pełnej Catalyst* Lithium Heparin Whole Blood Separator) oraz próbek osocza psiego pobranych na heparynę litową. Surowica jest również akceptowalna. Ważne jest, aby niezwłocznie (w ciągu 30 minut) oddzielić osocze albo surowicę od krwinek czerwonych albo skrzepu.

- W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.
- W przypadku pobierania surowicy **nie należy używać próbek z separatorem surowicy (SST)**, ponieważ żel zakłóca badanie stężenia progesteronu.
- Test Catalyst Progesterone jest odporny na wpływ żółtaczki i lipemii. Znaczna hemoliza (widoczna podczas kontroli wzrokowej surowicy/osocza) może powodować niedokładne wyniki oznaczenia progesteronu (fałszywie zaniżone).
- Nie należy rozcieńczać próbki.
- Szeregowe stężenia progesteronu można monitorować, wykorzystując ten sam typ próbki oraz metodę badania.
- Catalyst Progesterone został zaprojektowany do pomiaru naturalnie występującego progesteronu w próbkach pobranych od psów. Stosowanie suplementacji progesteronu może mieć wpływ na wyniki.

Nie należy narażać testów do oznaczania stężenia progesteronu na kontakt z preparatami do stosowania miejscowego zawierającymi progesteron (np. kremami na skórę człowieka). W przypadku stosowania takich kremów użytkownik powinien każdorazowo podczas korzystania z testu Catalyst Progesterone albo analizatorów Catalyst One* albo Catalyst Dx* zakładać czyste bezpudrowe rękawice lateksowe albo nitylowe. W przypadku kontaktu testów z preparatami zawierającymi progesteron wyniki testów uzyskane przy użyciu analizatorów Catalyst One i Catalyst Dx mogą być zawyżone.

Badania uzupełniające

W celu zwiększenia dokładności przewidywania owulacji i określania czasu krycia:

- należy monitorować trend wyników oznaczenia progesteronu przez szereg dni, dbając o stosowanie jednakowego rodzaju próbki i sposobu jej przetwarzania;
- z trendów dotyczących stężenia progesteronu należy korzystać w połączeniu z badaniem cytologicznym wymazu z pochwy;
- należy prowadzić obserwację (raz albo dwa razy dziennie) pod kątem wystąpienia zwiotczenia sromu.

W celu zwiększenia dokładności przewidywania daty porodu:

- należy monitorować trend wyników oznaczenia progesteronu przez szereg dni, dbając o stosowanie jednakowego rodzaju próbki i sposobu jej przetwarzania;
- z trendów dotyczących stężenia progesteronu należy korzystać w połączeniu z wiedzą o kryciu, wielokrotnymi pomiarami temperatury ciała i obserwacją objawów klinicznych;
- przed wykonaniem cięcia cesarskiego należy potwierdzić utrzymujące się obniżenie stężenia

progesteronu za pomocą wielokrotnych badań.

W niektórych przypadkach może być przydatne wykonanie dodatkowo badania stężenia LH (hormonu luteinizującego), w szczególności w przypadku używania nasienia mrożonego do sztucznego zapłodnienia.

Mogą różnić się wynikami i należy korzystać z adnotacji. W przypadku wyznaczania trendów dotyczących wyników oznaczenia stężenia progesteronu w celu określenia czasu owulacji należy zawsze stosować tą samą metodę badania i ten sam rodzaj próbek. Nie należy podejmować decyzji dotyczących rozrodu wyłącznie na podstawie badań stężenia progesteronu.

Sód (Na)

Sód jest głównym kationem znajdującym się w płynie zewnątrzkomórkowym, gdzie utrzymuje ciśnienie osmotyczne i równowagę kwasowo-zasadową oraz przekazuje impulsy nerwowe. Organizm utrzymuje łączne stężenie sodu na stałym poziomie, a nawet w przypadku stanu patologicznego odnotowywane są jedynie drobne wahania.

Główne powody wykonania badania

Ocena stanu elektrolitowego łącznie ze stężeniami potasu i chlorków.

Niskie stężenie sodu (hiponatremia) jest zazwyczaj powodowane przez stosunkowy nadmiar wody w organizmie. Obniżone stężenie może być spowodowane niskim spożyciem, utratą na skutek wymiotów albo biegunki, podczas dostatecznego nawadniania ale niedostatecznej suplementacji soli, nefropatią z utratą soli, diurezą osmotyczną, kwasicą metaboliczną oraz schorzeniami różnych gruczołów.

Podwyższone stężenie (hipernatremia) występuje zazwyczaj w wyniku utraty wody przewyższającej utratę soli poprzez intensywne pocenie się, ciężkich wymiotów albo biegunki, niedostatecznego nawadniania i odwodnienia albo retencji sodu przez nerki w hiperaldosteronizmie.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Hipernatremia (druga) wobec odwodnienia, utraty płynów przez przewód pokarmowy (wymioty albo biegunka).

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Należy unikać hemolizy. Obecność bromku potasu może powodować zawyżenie wyników oznaczenia elektrolitów podczas badań na anlizatorze.

Nie należy zamrażać próbek przeznaczonych do badania przy użyciu analizatora Catalyst One.

Badania uzupełniające

Należy zawsze oznaczać sód, potas i chlorki łącznie w celu określenia równowagi elektrolitowej. Sód + barwnik fluorescencyjny jonoforowy ęlanów umożliwia zmiana fluorescencji :tabolicznego, rowniowagi kwasowo-zasadowej i stanu fizjologicznego.

Przebieg reakcji

Sodium + ionophore – fluorescent dye → fluorescence change

Symetryczna dimetyloarginina (SDMA)

Symetryczna dimetyloarginina (SDMA) jest stabilną cząsteczką powstającą w wyniku potranslacyjnej metylacji reszt argininy w zlokalizowanych wewnątrzjądrowo białkach komórkowych kluczowych dla podstawowego metabolizmu komórki i w wyniku późniejszej degradacji białek. Wytwarzanie SDMA utrzymuje się na stałym poziomie i jest w dużej mierze niezależne od stanu organizmu, zaawansowanego wieku, diety, wysiłku, stanów chorobowych lub katabolizmu. SDMA jest wydalana z organizmu przez filtrację kłębuszkową w nerkach.

Główny cel wykonania badania

SDMA jest czułym biomarkerem wartości współczynnika przesączania kłębuszkowego.

W miarę obniżania czynności nerek stężenie SDMA wzrasta wcześniej niż stężenie kreatyniny, a w przeciwieństwie do kreatyniny, Na stężenie SDMA nie mają wpływu czynniki pozanerkowe, takie jak beztłuszczowa masa mięśniowa czy dieta.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie SDMA wskazuje na obniżenie współczynnika przesączania kłębuszkowego z powodu stanów przednerkowych (odwodnienie, niedociśnienie), nerkowych (ostre i czynne uszkodzenie nerek lub przewlekła choroba nerek) albo pozanerkowych (zastój moczu).

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Próbki, które można wykorzystać do wykonania testu Catalyst* SDMA w przypadku psów i kotów, to surowica, osocze i krew pełna (przy użyciu separatora krwi pełnej Catalyst* Lithium Heparin Whole Blood Separator). Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Nie należy rozcieńczać próbki.

Badania uzupełniające

W przypadku zmian czynności nerek związanych z podwyższonym stężeniem SDMA należy natychmiast podjąć działania i dokonać oceny, biorąc pod uwagę obraz kliniczny i wyniki badania lekarskiego. Uzupełniające badania laboratoryjne należy rozpocząć od wykonania pełnego badania ogólnego moczu i pełnego profilu biochemicznego, w tym oznaczenia stężeń kreatyniny, BUN, fosforanów nieorganicznych, białka całkowitego, albumin i elektrolitów. Zaleca się wykonanie badania morfologicznego krwi.

Należy przeprowadzić badania w kierunku podstawowej przyczyny prawdopodobnej choroby nerek, w tym posiew moczu i oznaczenie lekowrażliwości (minimalne stężenie hamujące [minimum inhibitory concentration, MIC]), badania w kierunku chorób zakaźnych i diagnostyczne badania obrazowe, jak również należy poszukiwać informacji o ekspozycji na związki o toksycznym działaniu na nerki albo leki nefrotoksyczne. Pacjentów z podwyższonym stężeniem SDMA należy również poddać ocenie pod kątem schorzeń zakłócających, wykonując pomiar ciśnienia krwi i oznaczenie stosunku białka do kreatyniny w moczu oraz badania czynności tarczycy.

Bilirubina całkowita (TBIL)

Hemoglobina z erytrocytów ulegających rozpadowi jest przekształcana do bilirubiny w układzie monocytarno-makrofagowym. Wolna, nieskoniugowana bilirubina jest transportowana w postaci związanej z albuminą do wątroby, gdzie ulega sprzęganiu z kwasem glukuronowym, a następnie jest wydalana z żółcią. W cholestatycznych chorobach wątroby wzrasta stężenie bilirubiny skoniugowanej we krwi.

Podczas hemolizy wewnątrznaczyniowej albo pozanaczyniowej mogą być szybko niszczone bardzo duże ilości erytrocytów, a mechanizm sprzęgania w wątrobie może ulec przeciążeniu, w związku z czym stwierdza się wysokie stężenie bilirubiny nieskoniugowanej we krwi. W przypadku bardzo znacznej utraty hemoglobiny i erytrocytów może dojść do niedotlenienia. Zaburzenia czynności hepatocytów powodują pęcznienie komórek, co prowadzi do niedrożności włosowatych kanalików żółciowych i uniemożliwia wydalanie bilirubiny skoniugowanej. Następnie dochodzi do równoczesnego wzrostu stężenia krążącej bilirubiny skoniugowanej.

Główny cel wykonania badania

Wykrycie choroby wątroby i dróg żółciowych oraz nadmiernego niszczenia erytrocytów.

Uwaga: u zdrowych psów i kotów stężenie bilirubiny całkowitej w surowicy jest bardzo niskie. Kontrola wzrokowa próbki pozwala często określić, czy konieczne jest oznaczenie stężenia bilirubiny (dotyczy wyłącznie surowicy i osocza).

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie bilirubiny – cholestatyczna choroba wątroby (bilirubina skoniugowana) i niewydolność wątroby (bilirubina nieskoniugowana), choroba hemolityczna (bilirubina nieskoniugowana i potencjalnie skoniugowana) oraz niedrożność wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. Próbki należy niezwłocznie poddać analizie, ponieważ bilirubina ulega szybkiej degradacji pod wpływem światła. Jeśli nie jest możliwa natychmiastowa analiza, należy przechowywać próbkę bez dostępu światła, najlepiej w lodówce w temperaturze 4°C–8°C. Przed wykonaniem analizy należy odczekać, aż próbka osiągnie temperaturę pokojową. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową.

Kluczowe jest odpowiednie odwirowanie próbki. W przeciwnym razie leukocyty i płytki krwi mogą pozostać w zawiesinie nawet w przypadku oddzielenia krwinek czerwonych. Obecność materiału komórkowego na slajdzie może spowodować istotny błąd zawyżenia. Ponadto obecność hemoglobiny powoduje zawyżenie wyników oznaczenia stężenia bilirubiny całkowitej, zatem należy unikać nawet umiarkowanej hemolizy próbek.

Badania uzupełniające

Oznaczenie stężenia bilirubiny całkowitej należy wykonywać łącznie z innymi badaniami czynności wątroby albo badaniami w kierunku uszkodzeń wątroby. Należy także oznaczyć hematokryt w celu wykluczenia albo potwierdzenia występowania choroby hemolitycznej. Może być przydatne również oznaczenie stężeń urobilinogenu i bilirubiny w moczu.

Przebieg reakcji



Białko całkowite (TP)

Stężenie białka całkowitego w surowicy obejmuje wszystkie białka obecne w fazie wodnej krwi. U zdrowych zwierząt głównym pojedynczym składnikiem są albuminy. Pozostałe białka stanowią alfa-, beta- i gamma-globuliny. Stężenie globulin określa się, odejmując stężenie albumin od stężenia białka całkowitego.

Główny cel wykonania badania

Oznaczenie stężenia białka całkowitego może dostarczyć użytecznych informacji, jeśli zostanie wykonane łącznie z badaniami oceniającymi czynność wątroby i nerek, stopień nawodnienia, badaniami w kierunku enteropatii z utratą białka albo gammopatii. Badanie jest nieswoiste, a w przypadku wykonania osobno prawdopodobnie nie dostarczy informacji o wartości diagnostycznej.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie białka całkowitego – odwodnienie, choroba zapalna.

Obniżone stężenie białka całkowitego – utrata białek w wyniku utraty krwi i utraty przez przewód pokarmowy, obniżone stężenie albumin związane z nefropatią i enteropatią z utratą białka, a także obniżone stężenie albumin związane z niewydolnością wątroby i chorobami zapalnymi.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby, odwodnienie i uszkodzenia przewodu pokarmowego.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Hemoliza w stopniu umiarkowanym do znacznego może powodować fałszywe zawyżenie stężenia białka całkowitego.

Wyniki uzyskane na podstawie analizy osocza mogą być nieznacznie wyższe niż w przypadku surowicy ze względu na fibrynogen pozostały w osoczu.

choroba nietarczycowa (NTI). W takich przypadkach należy rozważyć oznaczenie wolnej T₄ (fT₄), testu hamowania T₃ albo badania obrazowego tarczycy z użyciem radionuklidów, aby ułatwić potwierdzenie rozpoznania.

Trójglicerydy (TRIG)

Trójglicerydy są zazwyczaj obecne w diecie psów i kotów, szczególnie jeżeli zwierzęta są karmione resztkami ze stołu. Są one również syntetyzowane w wątrobie, głównie z węglowodanów, w celu zapewniania drugorzędowego źródła energii, i są magazynowane w tkance tłuszczowej. Ich hydroliza do mono- i diacylogliceroli oraz wolnych kwasów tłuszczowych jest katalizowana przez lipazę trzustkową.

Główny cel wykonania badania

Wykrycie nieprawidłowości metabolizmu lipidów.

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie trójglicerydów – dieta wysokotłuszczowa albo nieprawidłowości metabolizmu tłuszczów.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Nie należy pobierać krwi w ciągu 12 godzin po posiłku.

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Próbki, w których lipemia jest widoczna makroskopowo, prawdopodobnie zawierają bardzo dużą ilość trójglicerydów i należy rozcieńczyć je przed wykonaniem analizy.

Badania uzupełniające

Nie należy oznaczać stężenia trójglicerydów oddzielnie. Jeśli próbka jest mętna albo ma mleczne zabarwienie, test należy wykonywać łącznie z oznaczeniami stężeń cholesterolu i glukozy oraz badaniami czynności wątroby i nerek. Należy również rozważyć ponowne pobranie próbki, jeżeli pacjent nie pozostawał na czczo przez 12 godzin.

Przebieg reakcji



Kwas moczowy (URIC)

Oznaczenia stężenia kwasu moczowego są użyteczne u ptaków i dalmatyńczyków zamiast oznaczenia stężenia mocznika. U wszystkich psów (oprócz dalmatyńczyków) z wieloogniskową chorobą wątroby występuje znaczne podwyższenie stężenia kwasu moczowego we krwi powyżej prawidłowego stężenia wynoszącego <1 mg/dl.

Główny cel wykonania badania

Jako wskaźnik stopnia nasilenia choroby nerek w populacjach ptaków (i dalmatyńczyków).

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Podwyższone stężenie kwasu moczowego – azotemia przednerkowa, pozanerkowa i nerkowa z towarzyszącym obniżeniem współczynnika przesączania kłębuszkowego.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Osocze albo surowicę należy niezwłocznie oddzielić od komórek albo skrzepu. W przypadku pobierania osocza należy używać wyłącznie próbek pobranych na heparynę litową. Nie należy używać osocza pobranego na następujące środki konserwujące: fluorek sodu, cytrynian ani EDTA.

Badania uzupełniające

Kreatynina, UCRE/CREA, UPRO

Przebieg reakcji**Kreatynina w moczu (UCRE)**

Stężenie kreatyniny w moczu oznacza się, aby umożliwić oznaczenie ilościowe stężeń elektrolitów filtrowanych albo traconych przez kłębuszki albo kanaliki nerkowe, takich jak białko albo kortyzol w moczu, porównanie ich i wyrażenie w postaci proporcji/stosunków o istotności diagnostycznej.

Główny cel wykonania badania

Badanie należy przeprowadzić wraz z oznaczeniem białka w moczu, aby określić stosunek białka do kreatyniny w moczu (urine protein:creatinine ratio, UPC).

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Białkomocz wskazujący na wczesną chorobę nerek, nefropatię z utratą białka.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Odwirowany mocz, najlepiej pobierany przez nakłucie pęcherza moczowego, pobierany do czystego pojemnika. Przed przeprowadzeniem procedury należy wykazać nieaktywny osad moczu oraz wykluczyć zakażenie dróg moczowych (urinary tract infection, UTI) za pomocą posiewu oraz badań wrażliwości, ponieważ UTI może spowodować zwiększenie stosunku białka do kreatyniny w moczu w stopniu nieznacznym do umiarkowanego.

Badania uzupełniające


Badanie ogólne moczu, posiew oraz badanie wrażliwości. Badania biochemiczne surowicy, takie jak badanie stężenia kreatyniny, azotu mocznikowego we krwi, albumin i globulin.

Morfologia krwi

Test SNAP* 4Dx* Plus

Informacje dotyczące przechowywania

Próbki moczu należy poddać analizie w ciągu dwóch godzin od ich pobrania oraz można je przechowywać w lodówce przez maksymalnie 24 godziny. NIE zamrażać próbek moczu.

Przebieg reakcji**Białko w moczu (Urine Protein, UPRO)**

Białko w moczu oznacza się i porównuje ze stężeniem kreatyniny w celu oceny poziomu utraty białek w nerkach (kłębuszkach i kanalikach nerkowych), aby ustalić stosunek białka do kreatyniny (urine protein:creatinine, UPC).

Główny cel wykonania badania

Badanie należy przeprowadzić wraz z oznaczeniem kreatyniny w moczu, aby ustalić stosunek białka do kreatyniny (urine protein:creatinine, UPC).

Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w badaniu

Białkomocz wskazujący na wczesną niewydolność nerek – nefropatię z utratą białka.

Rodzaj próbki i środki ostrożności

Odwirowany mocz, najlepiej pobierany przez nakłucie pęcherza moczowego, pobierany do czystego pojemnika. Przed przeprowadzeniem procedury należy wykazać nieaktywny osad moczu oraz wykluczyć zakażenie dróg moczowych (urinary tract infection, UTI) za pomocą posiewu oraz badań wrażliwości, ponieważ UTI może spowodować zwiększenie stosunku białka do kreatyniny w moczu w stopniu nieznacznym do umiarkowanego.

Badania uzupełniające

Badanie ogólne moczu, posiew oraz badanie wrażliwości. Badania biochemiczne surowicy, takie jak badanie stężenia kreatyniny, azotu mocznikowego we krwi, albumin i globulin.

Morfologia krwi

Test SNAP* 4Dx* Plus

Informacje dotyczące przechowywania

Próbki moczu należy poddać analizie w ciągu dwóch godzin od ich pobrania oraz można je przechowywać w lodówce przez maksymalnie 24 godziny. NIE zamrażać próbek moczu.

Przebieg reakcji**Opisy protokołów medycznych****Protokół badania stężenia amoniaku**

Stężenie amoniaku w punkcie początkowym należy oznaczać u zwierząt, u których występują objawy encefalopatii wątrobowej albo u pacjentów, u których podejrzewa się przetoki systemowo-wrotne (portosystemic shunts, PSS). Można rozważyć przeprowadzenie badań w kierunku tolerancji amoniaku, aby ocenić przetoki systemowo-wrotne, gdy nie są analizowane kwasy żółciowe (na przykład w przypadku maltańczyków).

Badanie w kierunku tolerancji amoniaku: Próbką zostanie pobrana w punkcie początkowym, gdy pacjent będzie pozostawał na czczo przez 12 godzin. Chlorek amonu (0,1 g/kg) podawany doustnie przez zgłębnik żołądkowy albo w postaci kapsułek żelatynowych.

Druga próbka jest pobierana 30 minut po podaniu chlorku amonu.

Uwaga: Wymioty podczas wykonywania procedury unieważnią wyniki.

Wymogi dotyczące próbek: 1 ml osocza z heparyną, oddzielonego od krwinek czerwonych. Nie należy wykorzystywać surowicy.

Przechowywanie/trwałość: Próbki należy poddać analizie bezpośrednio po pobraniu. W przypadku przerwy pomiędzy pobraniem, odwirowaniem i analizą, próbki należy natychmiast zamknąć w pojemniku z lodem.

Zakłócenia: Hemoliza, stężenie glukozy powyżej 600 mg/dl (33,33 mmol/l), wysokie stężenie azotu mocznikowego we krwi

Komentarze: Próbki krwi z antykoagulantem należy odwirować bezpośrednio po pobraniu. Oddziel osocze i umieść je w szklanym pojemniku (RTT). Jeżeli próbki nie są od razu poddawane analizie, natychmiast je zamroź i przechowuj w stanie zamrożonym.

Uwaga: Z czasem stężenie amoniaku wzrasta.

Protokół UPC

Główny cel wykonania badania: Jako pomoc w rozpoznawaniu nefropatii z utratą białka, takich jak kłębuszkowe zapalenie nerek i amyloidoza, oraz jako marker wczesnego stadium przewlekłej niewydolności nerek.

Objemuje: Badanie na obecność białka w moczu (Urine protein, UPRO), oznaczenie stężenia kreatyniny w moczu (urine creatinine, UCRE), oznaczenie stosunku białka do kreatyniny (urine protein:creatinine, UPC)

Wymogi dotyczące próbek: 2 ml moczu w sterylnym pojemniku

Przechowywanie/trwałość: 48 godzin w temperaturze 2°C–8°C

Zakłócenia: Krwimocz makroskopowy, ropomocz.

Badania uzupełniające Badanie ogólne moczu, posiew oraz badanie wrażliwości. Badania biochemiczne surowicy, takie jak badanie stężenia kreatyniny, azotu mocznikowego we krwi, albumin i globulin, badanie morfologiczne krwi, badanie SNAP* 4Dx* Plus oraz badania obrazowe.

Interpretacja: W przypadku białkomoczu należy potwierdzić jego utrzymywanie się oraz pochodzenie – przednerkowe, nerkowe albo pozanerkowe. Potwierdź utrzymywanie się białkomoczu, powtarzając trzykrotnie badanie stosunku białka do kreatyniny z co najmniej dwutygodniowymi przerwami.

- Białkomocz przednerkowy może występować, gdy w badaniu morfologii krwi i profilu biochemicznym zostanie stwierdzona hemoliza, hiperglobulinemia albo dowody na uszkodzenie mięśni. Zaleć badania diagnostyczne i leczenie podstawowej przyczyny.
- Białkomocz pozanerkowy jest powodowany przez choroby układu moczowo-płciowego, krwimocz lub ropomocz. Powtórz badanie z użyciem próbki pobranej metodą cystocentezy albo oceń osad w moczu, aby stwierdzić, czy występuje krwotok albo stan zapalny. Rozważ wykonanie posiewu moczu. Zaleć badania diagnostyczne i leczenie podstawowej przyczyny.
- Białkomocz nerkowy: oceń w przypadku występowania azotemii.

Utrzymujący się białkomocz nerkowy bez azotemii (u psów i kotów):

UPC <0,5 = w normie

UPC 0,5–1,0 = wątpliwy wynik; powtórz w odpowiednim zakresie

UPC 1,0–2,0 = nadmierny białkomocz; zaleć badania diagnostyczne w kierunku współistniejących chorób ogólnoustrojowych

UPC 2,0 = nadmierny białkomocz; zaleć badania diagnostyczne w kierunku współistniejących chorób ogólnoustrojowych oraz leczenie

Utrzymujący się białkomocz nerkowy z azotemią (u psów):


UPC $<0,5$ = wymaga kontrolowania i badań diagnostycznych

UPC $\geq 0,5$ = nadmierny białkomocz; zaleć badania diagnostyczne w kierunku współistniejących chorób ogólnoustrojowych oraz leczenie

Utrzymujący się białkomocz nerkowy z azotemią (u kotów):


UPC $<0,4$ = wymaga kontrolowania i badań diagnostycznych

UPC $\geq 0,4$ = nadmierny białkomocz; zaleć badania diagnostyczne w kierunku współistniejących chorób ogólnoustrojowych oraz leczenie

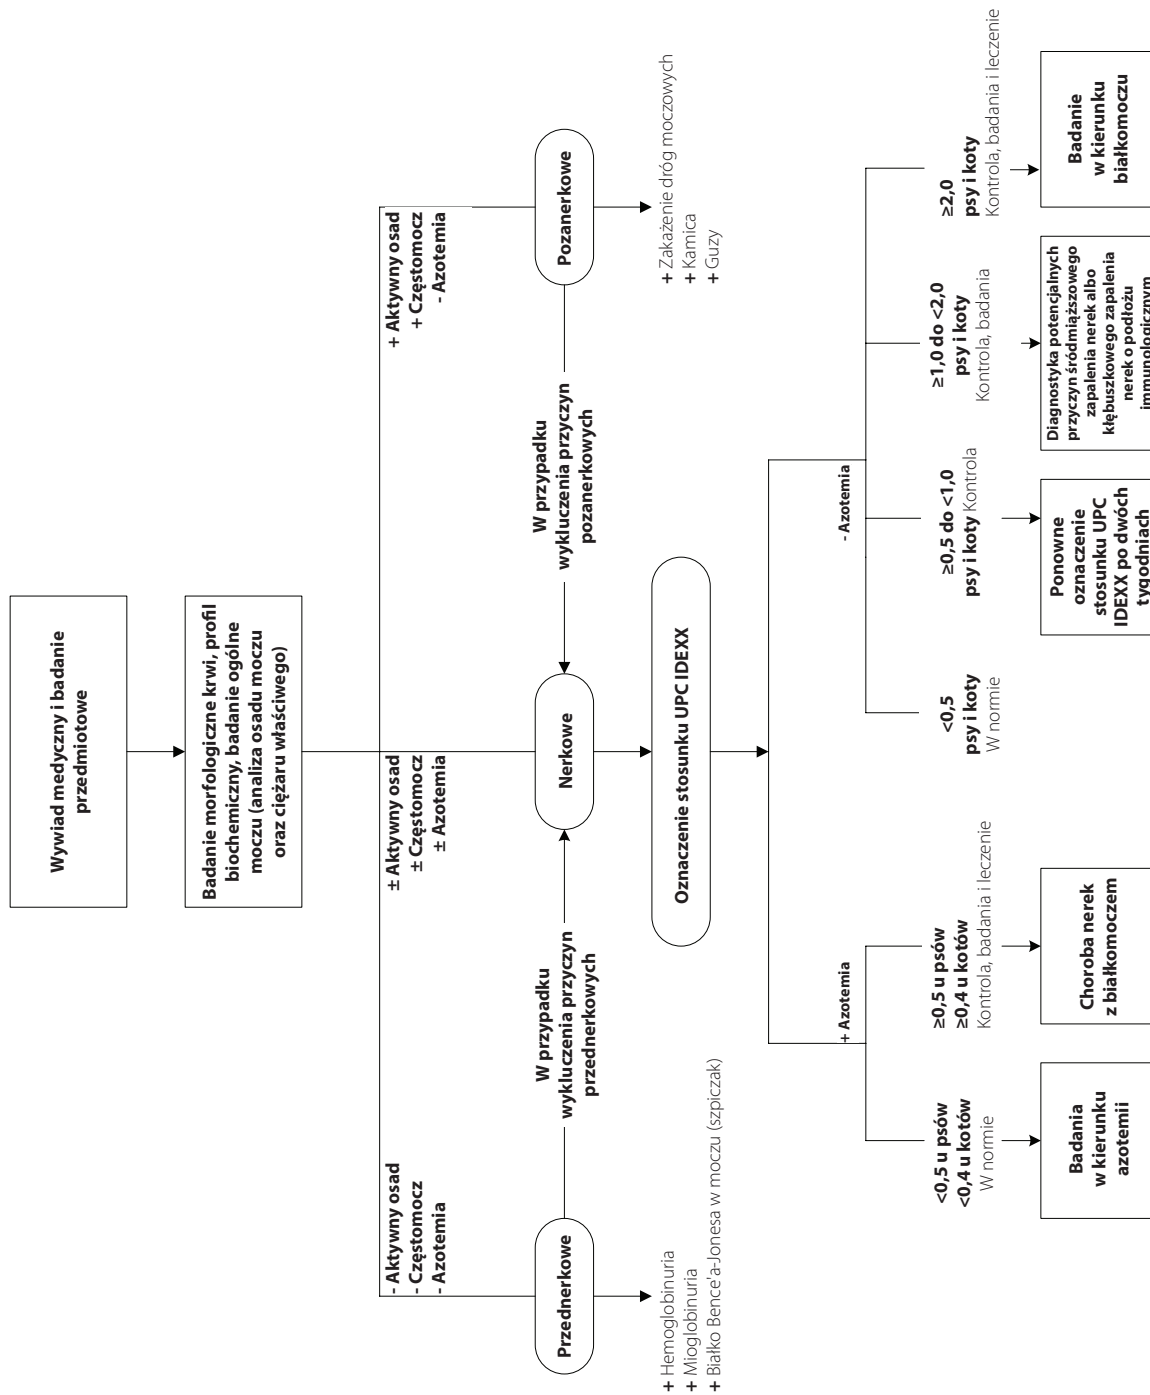


Protokoły badań całkowitej T₄

Podjęta niedoczynność tarczycy u psów

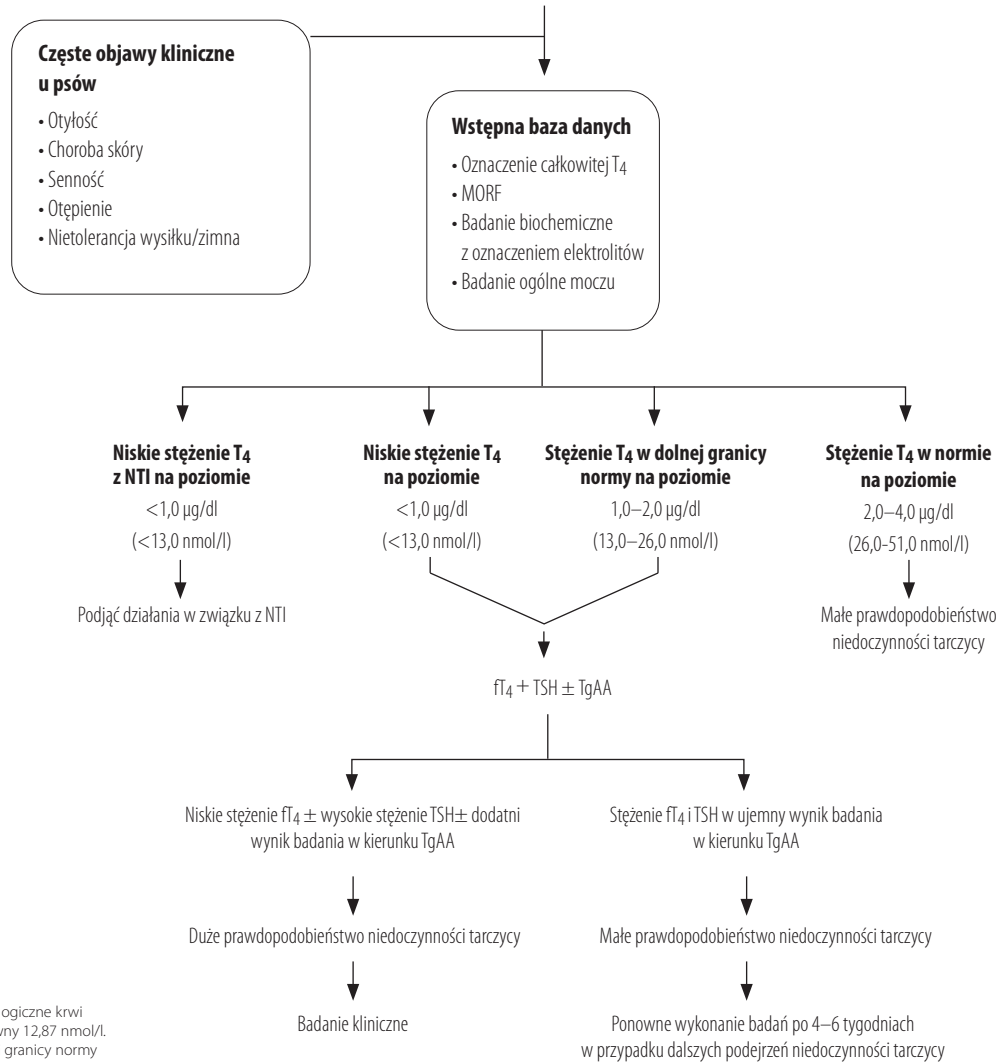

MORF = badanie morfologiczne krwi
Uwaga: 1 µg/dl jest równy 12,87 nmol/l.
 Wynik badania w dolnej granicy normy należy uznać za niejednoznaczny.

Podejrzewana nadczynność tarczycy u kotów

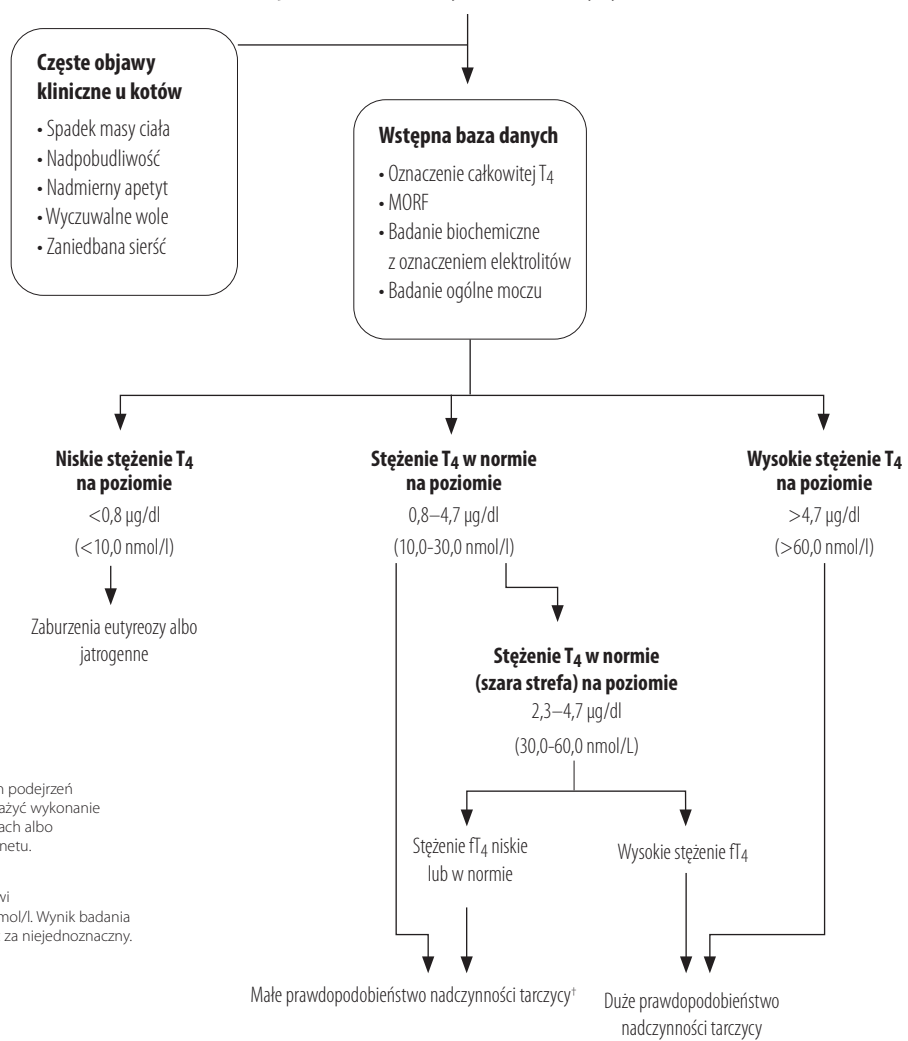

[†]W przypadku dalszych poważnych podejrzeń nadczynności tarczycy należy rozważyć wykonanie ponownych badań po 4–6 tygodniach albo wykonanie badania z użyciem technetu.

MORF = badanie morfologiczne krwi

Uwaga: 1 µg/dl jest równy 12,87 nmol/l. Wynik badania będzie w szarej strefie należy uznać za niejednoznaczny.

Różnice w wynikach

Z użyciem urządzeń laboratoryjnych dostępnych w sprzedaży albo innych urządzeń

Należy ustalić zakresy referencyjne dla każdej substancji badanej oraz każdego nowego urządzenia albo metody analizy. Każde laboratorium komercyjne musi ustalić własne zakresy referencyjne dla poszczególnych gatunków w zależności od wykorzystywanego sprzętu i metod. IDEXX nieustannie zapewnia to swoim klientom z każdą wersją oprogramowania.

Porównywanie wyników uzyskanych w różnych laboratoriach, które mogą korzystać z innego sprzętu lub metod, prowadzi w najlepszym przypadku do uzyskania nieprecyzyjnych wniosków. Do wszelkich porównań należy wykorzystywać tę samą próbkę, która została „podzielona” na mniejsze próbki przechowywane w podobnych warunkach oraz poddawane analizie mniej więcej w tym samym czasie. Porównaj każdy wynik z zakresem referencyjnym podanym przez IDEXX albo laboratorium komercyjne (w zależności od okoliczności). Każdy wynik powinien odnosić się do zakresu referencyjnego dla danej metody w ten sam sposób. Na przykład, gdy wynik uzyskany z analizy próbki z użyciem analizatora Catalyst One* jest nieznacznie poniżej normy określonej dla tego analizatora, wynik badania laboratoryjnego powinien być nieznacznie poniżej normy dla tego badania laboratoryjnego.

Parametry techniczne

Wymiary

Szerokość: 25,4 cm

Głębokość: 37,6 cm

Wysokość: 35,6 cm

Masa: około 10 kg

Zasilanie

Wejście: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 2 A

Zabezpieczenia elektroenergetyczne: IPX0

Parametry znamionowe: 24 VDC, 6,25 A

Przyłącza wejściowe/wyjściowe

Na tylnym panelu analizatora Catalyst One znajdują się dwa przyłącza wejściowe/wyjściowe dostępne dla użytkownika (przyłącze zasilania oraz złącze sieci Ethernet umożliwiające podłączenie do stacji IDEXX VetLab*).

Warunki pracy

Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych

Wysokość bezwzględna: Do 2000 metrów

	Eksplatacja	Przechowywanie
Temperatura	15°C–30°C (59°F–86°F)	5°C–38°C (41°F–100°F)
Wilgotność względna	15%–75%	20%–85%

Dane kontaktowe Działu Pomocy Technicznej IDEXX

Przedstawiciel handlowy IDEXX: _____

Numer telefonu/poczta głosowa: _____

Stany Zjednoczone: 1-800-248-2483

Australia: 1300 44 33 99

Austria: 43 (0)1 206 092 729

Belgia: 32 (0)27 00 64 38

Brazylia: 0800-777-7027

Kanada: 1-800-248-2483

Chiny (ChRL): 400-678-6682

Czechy: 420-239018034

Dania: 45 (0) 43 31 04 39

Finlandia: 358 (0)9 7252 2253

Francja: 33 (0) 810 433 999

Niemcy: 49 (0)69 153 253 290

Irlandia: 353 (0)1 562 1211

Włochy: 39 02 87 10 36 76

Japonia: 0120-71-4921

Ameryka Łacińska: Tecnico-latam@idexx.com

Luksemburg: 352 (0)34 20 80 87 22

Holandia: 31 (0)70 700 7033

Nowa Zelandia: 0800 83 85 22

Norwegia: 47 24 05 51 10

Polska: 48 22 853 40 01

Rosja: 7-4999-511-255

Singapur: 65 6807-6277

Słowacja: 421-268622417

Korea Południowa: 080 7979 133

Hiszpania: 34 932 672 660 albo 34 916 376 317

Szwecja: 46 (0)8 5198 9566

Szwajcaria: 41 (0)44 511 22 37

Tajwan: 0800 291 018

Wielka Brytania: 44 (0)20 3788 7508